


OKTAGON®

Contacte-nos para mais informações:

Telefone: +351 219 749 392

E-mail: info@nuncifarma.pt





ABREVIATURAS

AL	Nível do Pilar
BL	BONE LEVEL
BLT	BONE LEVEL TAPERED
C	CEREC
CO	CONICAL
GH	Altura gengival
H	Altura
IL	Nível do Implante
L	Comprimento
NC	NARROW CONNECT
RC	REGULAR CONNECT
RO	ROX-CERA
RP	REGULAR PLATFORM
TD	TAPERED
TL	TISSUE LEVEL
WP	WIDE PLATFORM

ABBREVIAZIONI

AL	Abutment Level
BL	BONE LEVEL
BLT	BONE LEVEL TAPERED
C	CEREC
CO	CONICAL
GH	Altezza gengivale
H	Altezza
IL	Implant Level
L	Lunghezza
NC	NARROW CONNECT
RC	REGULAR CONNECT
RO	ROX-CERA
RP	REGULAR PLATFORM
TD	TAPERED
TL	TISSUE LEVEL
WP	WIDE PLATFORM

ABREVIATURAS

AL	Nível del Pilar
BL	BONE LEVEL
BLT	BONE LEVEL TAPERED
C	CEREC
CO	CONICAL
GH	Altura gingival
H	Altura
IL	Nível de Implante
L	Longitud
NC	NARROW CONNECT
RC	REGULAR CONNECT
RO	ROX-CERA
RP	REGULAR PLATFORM
TD	TAPERED
TL	TISSUE LEVEL
WP	WIDE PLATFORM

CONTEÚDO | CONTENUTO | CONTENIDO

▶ Símbolos Simboli Símbolos - EN ISO 15223-1	8
▶ Certificado de garantía Certificato di garanzia Certificado de garantía	9

OKTAGON® CIRURGIA | CHIRURGIA | CIRUGÍA

▶ TISSUE LEVEL	10
Restaurações Indicazioni Restauraciones	12
Implantes Impianti Implantes	13
Dimensões Dimensioni Dimensiones	14
Pilares de cicatrização Abutment di guarigione Pilares de cicatrización	15
Instrumentos Strumenti Instrumentos	18
▶ BONE LEVEL	20
Restaurações Indicazioni Restauraciones	22
Implantes Impianti Implantes	23
Dimensões Dimensioni Dimensiones	24
Pilares de cicatrização Abutment di guarigione Pilares de cicatrización	25
Instrumentos Strumenti Instrumentos	28

OKTAGON® PROTÉTICA | PROTESI | PRÓTESIS

▶ TISSUE LEVEL RP	30
Impressão Presa d'impronta Toma de impresión	31
Cimentável Cementabili Cementable	32
Aparafusável Avitabile Atornillable	34
Bases adesivas de titânio Basi adesive in titanio Bases adhesivas de titanio	34
HÍBRIDO IBRIDA HIBRIDO	35
CAD/CAM CAD/CAM CAD/CAM	38
▶ TISSUE LEVEL WP	40
Impressão Presa d'impronta Toma de impresión	40
Cimentável Cementabili Cementable	40
Aparafusável Avitabile Atornillable	40
Bases adesivas de titânio Basi adesive in titanio Bases adhesivas de titanio	41
CAD/CAM CAD/CAM CAD/CAM	41
▶ BONE LEVEL NC	42
Impressão Presa d'impronta Toma de impresión	43
Cimentável Cementabili Cementable	44
Bases adesivas de titânio Basi adesive in titanio Bases adhesivas de titanio	44
Multi-Units Multi-Unit Multi-Units	45
CAD/CAM CAD/CAM CAD/CAM	45
Acessórios Multi-Unit Multi-Unit Accessori Accesorios Multi-Unit	46
HÍBRIDO IBRIDA HIBRIDO	46
▶ BONE LEVEL RC	48
Impressão Presa d'impronta Toma de impresión	49
Cimentável Cementabili Cementable	50
Bases adesivas de titânio Basi adesive in titanio Bases adhesivas de titanio	50
Multi-Units Multi-Unit Multi-Units	51
CAD/CAM CAD/CAM CAD/CAM	51
Acessórios Multi-Unit Multi-Unit Accessori Accesorios Multi-Unit	52
HÍBRIDO IBRIDA HIBRIDO	52

INSTRUMENTOS | STRUMENTI | INSTRUMENTOS



















▶ Ferramentas Ausiliari Herramientas	55
▶ Acessórios Accessori Accesorios	56

INFORMAÇÕES | INFORMAZIONI | INFORMACIÓN

▶ Valores de torque e rotação Torque e numero di giri Momentos de torsión y velocidades de giro	58
▶ Materiais Materiali Materiales	59
▶ Garantia da qualidade Controllo qualità Aseguramiento de la calidad	60
▶ Certificação Certificazione Certificación	61
▶ Informações gerais Note generali Información general	62

▶ SÍMBOLOS | SIMBOLI | SÍMBOLOS - EN ISO 15223-1

Símbolos de aplicação na embalagem do implante
 Simboli di applicazione sulla confezione dell'implanto
 Símbolos de aplicación en el envase del implante

 <p>Número do lote Numero di lotto Código de lote</p>	 <p>Fabricante Fabbricante Fabricante</p>
 <p>Número de artigo Número de artículo Codice articoloc</p>	 <p>Distributor Distributor Distributeur</p>
 <p>Símbolo de certificação GFA demonstrando a conformidade das embalagens de produto com as normas FSC®. Simbolo di certificazione GFA che attesta la conformità delle confezioni dei prodotti con gli standard FSC®. Símbolo de certificación GFA que demuestra la conformidad de los embalajes de los productos con las normas FSC®.</p>	<p>CUIDADO: a lei federal dos EUA limita a venda deste produto exclusivamente a médicos ou por ordem destes ATTENZIONE: la legge federale degli Stati Uniti limita la vendita di questo prodotto unicamente a medici qualificati o su loro prescrizione ATENCIÓN: La ley federal estadounidense limita la venta de este producto a médicos con licencia o por prescripción de los mismos</p> 
 <p>Raios gama com um mín. de 25 kGy (2,5 Mrad) Raggi gamma con almeno 25 kGy (2.5 Mrad) Rayos gamma con mín. 25 kGy (2,5 Mrad)</p>	 <p>Descartável Prodotto monouso Un solo uso</p>
 <p>Observar as instruções de utilização Seguire le istruzioni per l'uso Observar las instrucciones de uso</p>	 <p>Manter ao abrigo da luz solar Conservare al riparo dalla luce solare Manténgase fuera de la luz del sol</p>
 <p>Não reesterilizar Non risterilizzare No reesterilizar</p>	 <p>Sistema único de barreira estéril Sistema di barriera sterile singola Sistema de barrera estéril único</p>
 <p>Prazo de validade: 5 anos, usar até: AAAA-MM Validità: 5 anni, utilizzare entro: YYYY-MM Fecha de caducidad: 5 años, utilizable hasta: AAAA-MM</p>	 <p>Duplo sistema de barreira estéril Sistema di barriera sterile doppia Sistema de barrera estéril doble</p>
 <p>Data de fabrico Data di produzione Fecha de fabricación</p>	 <p>Identificador único de um produto médico Identificativo unico del dispositivo medico Identificador único de un producto médico</p>
 <p>Não utilizar se a embalagem estiver danificada Non utilizzare se la confezione è danneggiata No utilizar si el envase está dañado</p>	 <p>Dispositivo médico Dispositivo medico Produit médical</p>

GUARANTEE CERTIFICATE



MEISINGER
IMPLANTS

The guarantee applies to the OKTAGON® Implant System from MEISINGER IMPLANTS GmbH and includes a lifetime guarantee on all implants in the OKTAGON® product portfolio, as well as a ten-year guarantee on OKTAGON® abutments.

The guarantee covers manufacturing and material defects. Free implant replacement is provided by MEISINGER IMPLANTS GmbH without further additional costs.

No new guarantee or extension of the guarantee is associated with the guarantee service.

OKTAGON® IMPLANTS
WITH **LIFETIME** GUARANTEE



OKTAGON® ABUTMENTS
WITH **TEN-YEARS** GUARANTEE



No guarantee is provided in case of:

- ▶ Implant loss in the case of immediate restorations or due to external influences (accidents, trauma, incorrect treatment, etc.)
- ▶ Implant loss due to non-observance of contraindications (taking medication, drug and alcohol abuse, tobacco consumption, metabolic diseases, etc.)
- ▶ Failure of third-party products (e.g. due to material or manufacturing defects)
- ▶ Custom-made products or modified products

Further claims and consequential damages such as laboratory costs and clinical follow-up treatments are excluded from the guarantee.

This voluntary guarantee is in addition to the statutory guarantee claims and product liability and does not affect them. Our general terms and conditions shall apply in addition.

GUARANTEE CERTIFICATE



TISSUE LEVEL

CIRURGIA
CHIRURGIA
CIRUGÍA



Plataforma protética
bem conhecida

Plattaforma protesica
ben nota

Plataforma protésica
bien conocida



Superfície jateada com areia de
grão largo e tratada com ácido

**Superficie sabbiata a grana
Larga e trattata con Acido**

Superficie arenada de grano
ancho y tratada con ácido

▶ OKTAGON® TISSUE LEVEL · IMPLANTES | IMPIANTI | IMPLANTES

O implante TISSUE LEVEL tem sido, desde há décadas, um dos implantes mais utilizados. Foi concebido para uma cicatrização trans ou subgingival a nível dos tecidos moles. Devido ao seu excelente perfil de emergência com um deslocamento vertical da plataforma o implante oferece ótimas condições para os tecidos envolventes.


A sua plataforma vertical, com uma distância de 1.8 mm à crista óssea, faz com que a conexão entre o implante e o pilar seja facilmente acessível durante a restauração protética. Isto é particularmente vantajoso no sector posterior e em maxilares endêntulos. A remoção dos resíduos de cimento na fase protética não afecta tanto o perfil de emergência como acontece nos implantes colocados de modo crestal ou sub crestal. O implante TISSUE LEVEL está disponível em duas versões, cilíndrica e cónica (CONICAL).

L'implanto TISSUE LEVEL è tra gli impianti più utilizzati da decenni. L'implanto è concepito per la guarigione trans- o subgingivale a livello dei tessuti molli. Grazie al buon profilo di emergenza con spostamento verticale della piattaforma, l'implanto offre condizioni ottimali per il tessuto molle circostante.

Lo spostamento verticale della piattaforma, ad una distanza di 1.8 mm dall'osso crestale, consente di accedere agevolmente alla connessione impianto-abutment nella ricostruzione protesica. Tale proprietà risulta particolarmente vantaggiosa nella regione latero-posteriore e in caso di arcate edentule. La rimozione dei residui di cemento nella fase protesica interferisce con il profilo di emergenza in misura molto meno significativa rispetto agli impianti inseriti a livello crestale o subcrestale. L'implanto TISSUE LEVEL è disponibile in due versioni, cilindrica e conica (CONICAL).

El implante TISSUE LEVEL es, desde hace décadas, uno de los implantes más utilizados. Está concebido para una cicatrización trans o subgingival al nivel del tejido. Gracias a su excelente perfil de emergencia con un desplazamiento vertical de la plataforma, el implante ofrece las condiciones perfectas para el tejido blando circundante.


Este desplazamiento vertical de la plataforma, con una distancia de 1.8 mm respecto al hueso crestal, hace que la conexión entre el implante y el pilar sea fácilmente accesible durante la restauración protésica. Esto resulta especialmente ventajoso en el sector posterior y en los maxilares edéntulos. La retirada de los restos de cemento en la fase protésica no afecta tanto al perfil de emergencia como sí sucede en aquellos implantes colocados de modo crestal o subcrestal. El implante TISSUE LEVEL está disponible en dos versiones: cilíndrica y cónica (CONICAL).

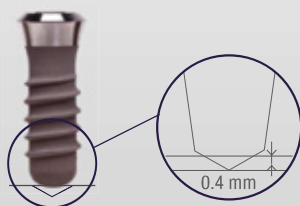







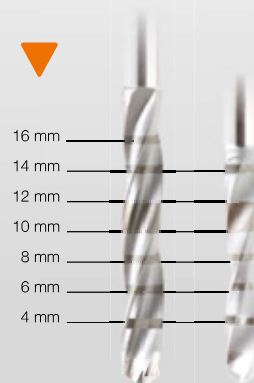








As pontas da Broca helicoidal \varnothing 2.2/2.8 mm têm um sobrecomprimento apical (até 0.4 mm) em comparação com a profundidade de inserção do implante.

Le punte delle frese a spirale \varnothing 2.2/2.8 mm presentano una lunghezza extra apicale (fino a 0.4 mm) rispetto alla profondità di inserimento dell'implanto.

Las puntas de las fresas helicoidales \varnothing 2.2/2.8 mm tienen una sobrelongitud apical (hasta 0.4 mm) en comparación con la profundidad de inserción del implante.

















TISSUE LEVEL · RESTAURAÇÕES | INDICAZIONI | RESTAURACIONES






		Ø mm		Comprimento Lunghezza Longitud	Coroa individual Corona singola Corona unitaria	Telescópio Telescopica Telescopio	Barra Barra Barra	Ponte Ponte Puente	Pilar sólido Componente secundaria piena Pilar macizo	Encaixe esférico retentivo Ancoraggio a testa Sferico Anclaje de bola retentivo	ALLIGATOR		
TISSUE LEVEL RP	3.3		STANDARD		8			✓ 1)	✓ 2)	✓ 2)			
					10			✓ 1)	✓ 2)	✓ 2)			
					12			✓ 1)	✓ 2)	✓ 2)			
					14			✓ 1)	✓ 2)	✓ 2)			
	3.75		STANDARD ROX-CERA		8		✓ 3)	✓ 1)	✓ 1)	✓ 1)	✓ 3)	✓ 3)	
					10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
					12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
					8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	4.1		STANDARD		6		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
					8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
					10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
					12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			4.1	TAPERED		10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
						12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			4.1	CONICAL		8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
						10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
						12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			4.1	ROX-CERA		8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
						10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
						12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.8		STANDARD		6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
				8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
				10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
				12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4.8		STANDARD		8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
				10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
				12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
WP		STANDARD		8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
				10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
				12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		




NOTA 1) Restauração com barra sobre 4 implantes
Ricostruzione poggiante su 4 impianti
Restauración con barra sobre 4 implantes

2) Como pilar de ponte, bloqueado com um implante Ø 4.1/4.8 mm
Come abutment di ponte, con un impianto Ø 4.1/4.8 mm
Como pilar para barra, ferulizado con un implante Ø 4.1/4.8 mm

3) Restauração sobre 4 implantes com telescópio ou ALLIGATOR
Ricostruzione su 4 impianti con telescopica o ALLIGATOR
Restauración sobre 4 implantes con telescopio o ALLIGATOR

72186		TL RP Implante	parafuso de fecho estéril 31154 incl.	Ø 3.3 mm		L 8.0 mm
72187		TL RP Implante	vite di chiusura sterile 31154 incl.			L 10.0 mm
72199		TL RP Implante	tornillo de cierre estéril 31154 incl.			L 12.0 mm
72267						L 14.0 mm
31140		TL RP Implante	parafuso de fecho estéril 31154 incl.	Ø 3.75 mm		L 8.0 mm
31141		TL RP Implante	vite di chiusura sterile 31154 incl.			L 10.0 mm
31142		TL RP Implante	tornillo de cierre estéril 31154 incl.			L 12.0 mm
31149		TL RP Implante	parafuso de fecho estéril 31154 incl.	Ø 4.1 mm		L 6.0 mm
31151		TL RP Implante	vite di chiusura sterile 31154 incl.			L 8.0 mm
31152		TL RP Implante	tornillo de cierre estéril 31154 incl.			L 10.0 mm
31153						L 12.0 mm
82647						L 14.0 mm
38150		TL RP Implante TAPERED	parafuso de fecho estéril 31154 incl.	Ø 4.1 mm		L 10.0 mm
		TL RP Implante TAPERED	vite di chiusura sterile 31154 incl.			
38415		TL RP Implante TAPERED	tornillo de cierre estéril 31154 incl.			L 12.0 mm
31147		TL RP Implante CONICAL	parafuso de fecho estéril 31154 incl.	Ø 4.1 mm		L 8.0 mm
31150		TL RP Implante CONICAL	vite di chiusura sterile 31154 incl.			L 10.0 mm
31175		TL RP Implante CONICAL	tornillo de cierre estéril 31154 incl.			L 12.0 mm
50124		TL RP Implante	parafuso de fecho estéril 31154 incl.	Ø 4.8 mm		L 6.0 mm
50125		TL RP Implante	vite di chiusura sterile 31154 incl.			L 8.0 mm
50347		TL RP Implante	tornillo de cierre estéril 31154 incl.			L 10.0 mm
50348						L 12.0 mm
31154		TL RP Parafuso de fecho				GH 0.0 mm
		TL RP Vite di chiusura				
31155		TL RP Tornillo de cierre				GH 1.5 mm

72200		TL RP Implante ROX-CERA	parafuso de fecho estéril 31154R incl.	Ø 3.3 mm		L 8.0 mm
72201		TL RP Implante ROX-CERA	vite di chiusura sterile 31154R incl.			L 10.0 mm
72202		TL RP Implante ROX-CERA	tornillo de cierre estéril 31154R incl.			L 12.0 mm
31169		TL RP Implante ROX-CERA	parafuso de fecho estéril 31154R incl.	Ø 4.1 mm		L 8.0 mm
31170		TL RP Implante ROX-CERA	vite di chiusura sterile 31154R incl.			L 10.0 mm
31171		TL RP Implante ROX-CERA	tornillo de cierre estéril 31154R incl.			L 12.0 mm
31154R		TL RP Parafuso de fecho	com revestimento Cerid® 45 ON			GH 0.0 mm
		TL RP Vite di chiusura	con rivestimento Cerid® 45 ON			
		TL RP Tornillo de cierre	con revestimento Cerid® 45 ON			

93727		TL WP Implante	parafuso de fecho estéril 93730 incl.	Ø 4.8 mm		L 8.0 mm
93728		TL WP Implante	vite di chiusura sterile 93730 incl.			L 10.0 mm
93729		TL WP Implante	tornillo de cierre estéril 93730 incl.			L 12.0 mm
93730		TL WP Parafuso de fecho				GH 0.0 mm
		TL WP Vite di chiusura				
		TL WP Tornillo de cierre				

TISSUE LEVEL · DIMENSÕES | DIMENSIONI | DIMENSIONES

TISSUE LEVEL SURGERY

TISSUE LEVEL RP  Ø 3.3 mm



TISSUE LEVEL RP  Ø 3.75 mm



TISSUE LEVEL RP  Ø 4.1 mm



TISSUE LEVEL RP  Ø 4.1 mm






TISSUE LEVEL RP  Ø 4.8 mm



Altura do colo do parafuso 1.8 mm
 Altezza del collo lucidato 1.8 mm
 Altura del cuello pulido 1.8 mm

TISSUE LEVEL WP  Ø 4.8 mm



* APICAL Ø APICALE Ø Ø APICAL	STANDARD	ROX-CERA	TAPERED	CONICAL
 Ø mm	2.8	2.8		
 Ø mm	3.25			
 Ø mm	3.5	3.5	3.45	~2.6
 Ø mm	4.2			

** sem rosca | senza filettatura | sin rosca

▶ PILARES DE CICATRIZAÇÃO | ABUTMENT DI GUARIGIONE | PILARES DE CICATRIZACIÓN

TL RP	31154	31154R*	31155
Parafusos de fecho Vite di chiusura Tornillo de cierre			
	GH 0.0 mm	GH 0.0 mm	GH 1.5 mm

TL RP	35683	35736	35751
Pilares de cicatrização Abutment di guarigione Tornillos de cicatrización			
Ø 5.5 mm	GH 2.0 mm	GH 3.0 mm	GH 4.5 mm


TL WP	93730
Parafusos de fecho Vite di chiusura Tornillo de cierre	
	GH 0.0 mm

TL WP	93731	93732	93733
Pilares de cicatrização Abutment di guarigione Tornillos de cicatrización			
Ø 7.2 mm	GH 2.0 mm	GH 3.0 mm	GH 4.5 mm


* Revestimento **ROX-CERA** Cerid® 45 ON a pedido | Rivestimento **ROX-CERA** Cerid® 45 ON su richiesta | Revestimiento **ROX-CERA** Cerid® 45 ON previa

TISSUE LEVEL RP/WP · CIRURGIA | CHIRURGIA | CIRUGÍA

TISSUE LEVEL SURGERY

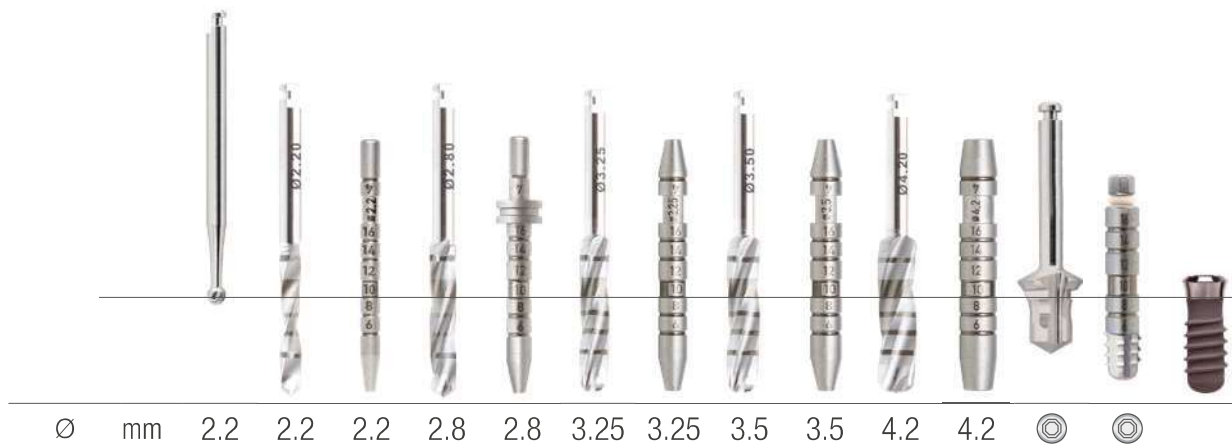


Representação exemplificativa do protocolo de perfuração | Illustrazione a titolo d'esempio dei protocolli di fresatura | Representación ilustrativa del protocolo de fresado

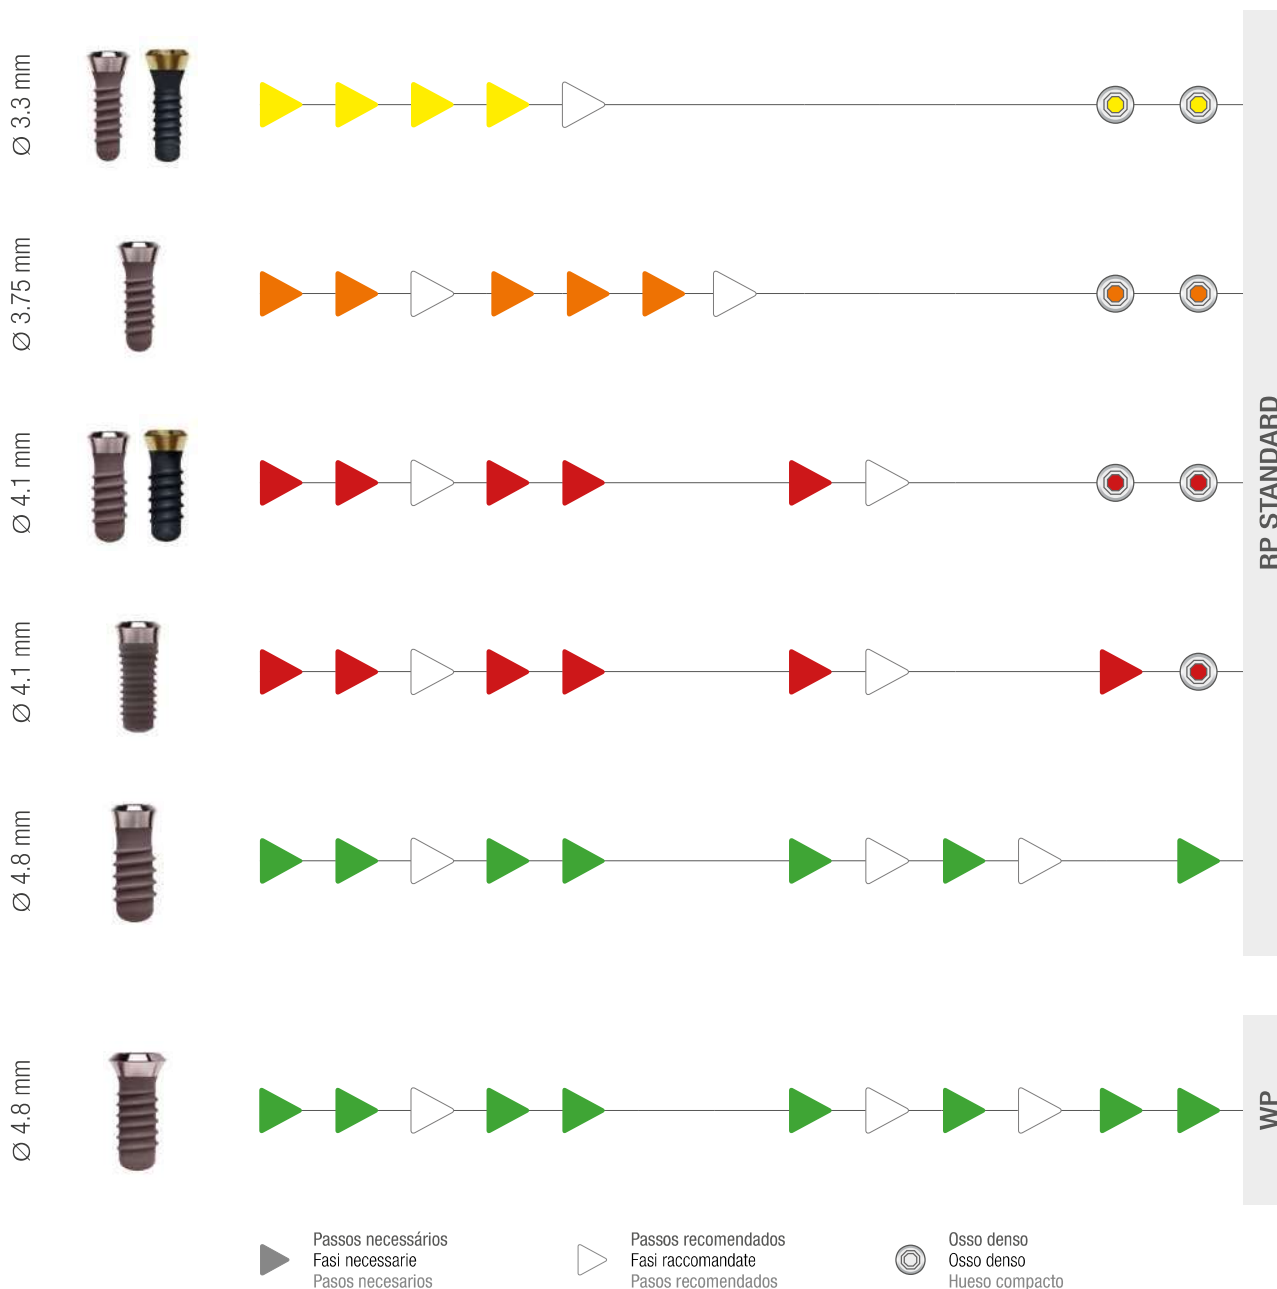


TISSUE LEVEL RP CONICAL · CIRURGIA | CHIRURGIA | CIRUGÍA



Representação exemplificativa do protocolo de perfuração | Illustrazione a titolo d'esempio dei protocolli di fresatura | Representación ilustrativa del protocolo de fresado

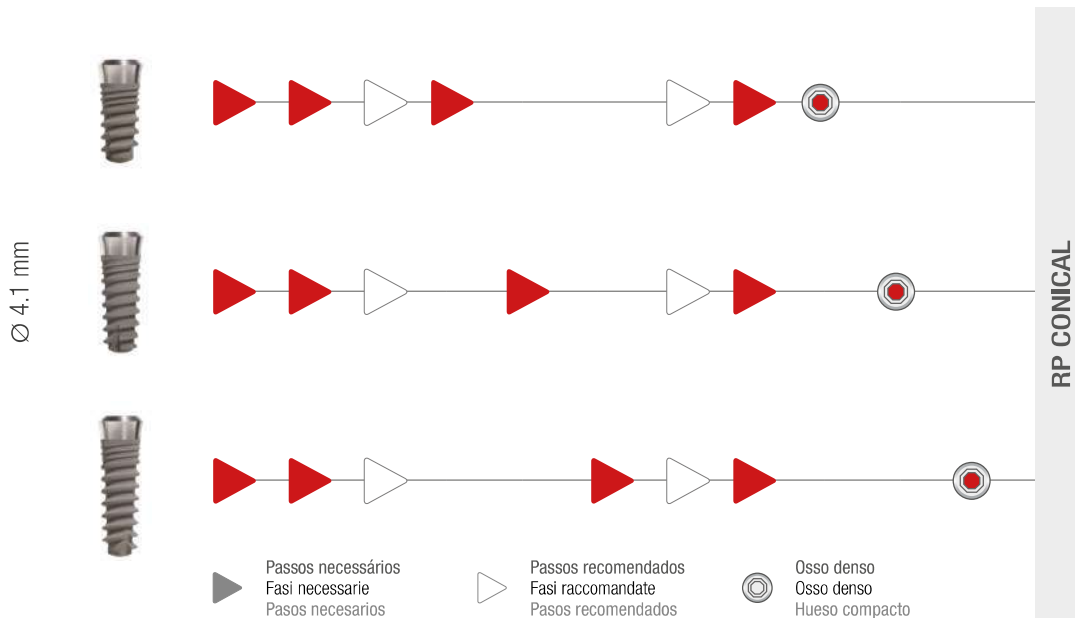

Nota As brocas helicoidais e os promotores de rosca devem ser usados de acordo com o comprimento do implante.
Nota Utilizzare frese a spirale e maschiatori in base alla lunghezza dell'implanto.
Nota Las fresas helicoidales y los machos de rosca se deben usar conforme a la longitud del implante.

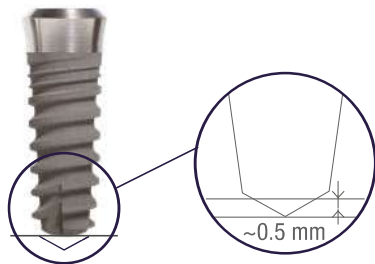

As pontas das brocas espirais CONICAL têm um sobrecomprimento apical em comparação com a profundidade de inserção do implante.

Le punte delle frese a spirale CONICAL presentano una lunghezza extra apicale rispetto alla profondità di inserimento dell'implanto

Las puntas de las fresas helicoidales CONICAL tienen una sobrelongitud apical en comparación con la profundidad de inserción del implante.













O protocolo de perfuração usado depende da densidade óssea.
 A seconda della densità ossea si utilizzano diversi protocolli di fresatura.
 Dependiendo de la densidad del hueso se utilizarán diferentes protocolos de fresado.


















TISSUE LEVEL · INSTRUMENTOS | STRUMENTI | INSTRUMENTOS

31061	TL/BL Broca esférica TL/BL Fresa a rosetta TL/BL Fresa de bola	Ø 2.2 mm	L 34.0 mm
11594	TL/BL Broca piloto TL/BL Fresa pilota TL/BL Fresa piloto	Ø 1.54 mm	L 33.0 mm
38120	TL/BL Broca helicoidal TL/BL Fresa spirale	Ø 2.2 mm	L 33.0 mm
38121	TL/BL Fresa helicoidal		L 41.0 mm
38149	TL/BL Broca helicoidal TL/BL Fresa spirale	Ø 2.8 mm	L 33.0 mm
38148	TL/BL Fresa helicoidal		L 41.0 mm
38130	TL/BL Broca helicoidal TL/BL Fresa spirale	Ø 3.25 mm	L 33.0 mm
38131	TL/BL Fresa helicoidal		L 41.0 mm
38135	TL/BL Broca helicoidal TL/BL Fresa spirale	Ø 3.5 mm	L 33.0 mm
38136	TL/BL Fresa helicoidal		L 41.0 mm
38151	TL/BL Broca helicoidal TL/BL Fresa spirale	Ø 4.2 mm	L 33.0 mm
38152	TL/BL Fresa helicoidal		L 41.0 mm
38155	TL RP Broca helicoidal CONICAL para implante de 8 mm TL RP Fresa spirale CONICAL per l'impianto 8 mm TL RP Fresa helicoidal CONICAL para implante 8 mm	Ø 2.8 - 3.7 mm	L 28.0 mm
38154	TL RP Broca helicoidal CONICAL para implante de 10 mm TL RP Fresa spirale CONICAL per l'impianto 10 mm TL RP Fresa helicoidal CONICAL para implante 10 mm	Ø 2.7 - 3.7 mm	L 30.0 mm
38157	TL RP Broca helicoidal CONICAL para implante de 12 mm TL RP Fresa spirale CONICAL per l'impianto 12 mm TL RP Fresa helicoidal CONICAL para implante 12 mm	Ø 2.5 - 3.7 mm	L 32.0 mm

64566	OKTAGON® Guia de Paralelização OKTAGON® Guida di parallelismo OKTAGON® Guía de paralelización	Ø 2.2 mm	2 un. 2 pz. 2 uu.	L 27.0 mm
64567	OKTAGON® Calibrador de profundidade com indicador de distância OKTAGON® Misuratore di profondità con indicatore di distanza OKTAGON® Calibrador de profundidad con indicador de distancia	Ø 2.2/2.8mm		L 27.0 mm
64568	OKTAGON® Calibrador de profundidade OKTAGON® Misuratore di profondità OKTAGON® Calibrador de profundidad	Ø 3.25 mm		L 27.0 mm
64569	OKTAGON® Calibrador de profundidade OKTAGON® Misuratore di profondità OKTAGON® Calibrador de profundidad	Ø 3.5 mm		L 27.0 mm
64570	OKTAGON® Calibrador de profundidade OKTAGON® Misuratore di profondità OKTAGON® Calibrador de profundidad	Ø 4.2 mm		L 27.0 mm

TISSUE LEVEL · INSTRUMENTOS | STRUMENTI | INSTRUMENTOS

38137		TL RP Broca de perfil TL RP Fresa svasata TL RP Fresa de perfil	Ø 3.3 mm		L 25.0 mm
38132		TL RP Broca de perfil TL RP Fresa svasata TL RP Fresa de perfil	Ø 3.75 mm		L 25.0 mm
38147		TL RP Broca de perfil TL RP Fresa svasata TL RP Fresa de perfil	Ø 4.1 mm		L 25.0 mm
38153		TL RP Broca de perfil CONICAL TL RP Fresa svasata CONICAL TL RP Fresa de perfil CONICAL	Ø 4.1 mm		L 25.0 mm
93740		TL RP Broca de perfil TAPERED TL RP Fresa svasata TAPERED TL RP Fresa de perfil TAPERED	Ø 4.1 mm		L 37.0 mm
93738		TL WP Broca de perfil TL WP Fresa svasata TL WP Fresa de perfil	Ø 4.8 mm		L 25.0 mm

95270		TL RP Promotor de rosca TL RP Maschiatore TL RP Macho de rosca	Ø 3.3 mm		L 23.0 mm
38134		TL RP Promotor de rosca TL RP Maschiatore TL RP Macho de rosca	Ø 3.75 mm		L 23.0 mm
95271		TL RP Promotor de rosca TL RP Maschiatore TL RP Macho de rosca	Ø 4.1 mm		L 23.0 mm
95272		TL RP/WP Promotor de rosca TL RP/WP Maschiatore TL RP/WP Macho de rosca	Ø 4.8 mm		L 23.0 mm
95261		TL RP Promotor de rosca CONICAL para implante de 8 mm TL RP Maschiatore CONICAL per l'impianto 8 mm TL RP Macho de rosca CONICAL para implante 8 mm	Ø 2.8/4.1 mm		L 21.0 mm
95268		TL RP Promotor de rosca CONICAL para implante de 10 mm TL RP Maschiatore CONICAL per l'impianto 10 mm TL RP Macho de rosca CONICAL para implante 10 mm	Ø 2.7/4.1 mm		L 23.0 mm
95262		TL RP Promotor de rosca CONICAL para implante de 12 mm TL RP Maschiatore CONICAL per l'impianto 12 mm TL RP Macho de rosca CONICAL para implante 12 mm	Ø 2.5/4.1 mm		L 25.0 mm
95264		TL RP Promotor de rosca TAPERED TL RP Maschiatore TAPERED TL RP Macho de rosca TAPERED	Ø 4.1 mm		L 23.0 mm



BONE LEVEL

CIRURGIA

CHIRURGIA

CIRUGÍA



Plataforma protética
bem conhecida

Plattaforma protesica
ben nota

Plataforma protésica
bien conocida

Superfície jateada com areia de
grão largo e tratada com ácido

Superfície sabbiata con sabbia a
grana **L**arga e trattata con **A**cido

Superficie arenada de grano
ancho y tratada con ácido



▶ OKTAGON® BONE LEVEL · IMPLANTES | IMPIANTI | IMPLANTES

Além dos implantes TISSUE LEVEL, há já muito tempo que estão também disponíveis implantes BONE LEVEL para a restauração ao nível do osso. Estes implantes oferecem uma abordagem mais flexível para permitir um perfil de emergência individual, servindo assim para conseguir resultados estéticos melhores.


Pilares de cicatrização de diversos diâmetros permitem um perfil de emergência muito mais natural, oferecendo, assim, uma maior flexibilidade, sobretudo na região anterior. Nas intervenções bifásicas, os implantes Bone Level são mais fáceis de cobrir com tecido mole, bem como em casos de baixa estabilidade primária ou de regeneração óssea controlada (GBR). O implante Bone Level está disponível em duas versões, cilíndrica e cônica (BLT).

Oltre agli impianti TISSUE LEVEL, da tempo sono disponibili anche impianti BONE LEVEL per restauri a livello osseo. Questi impianti offrono un approccio più flessibile, che consente un profilo di emergenza individuale, e contribuiscono a ottenere migliori risultati estetici.

Gli abutment di guarigione disponibili in diversi diametri permettono di creare un profilo di emergenza molto più naturale e offrono quindi un alto grado di flessibilità, in particolare nella regione anteriore. Nelle procedure a due fasi, gli impianti Bone Level risultano più facili da coprire con tessuto molle, così come nei casi di scarsa stabilità primaria o durante la rigenerazione ossea guidata (GBR). L'impianto Bone Level è disponibile in due versioni, cilindrica e conica (BLT).

Además de los implantes TISSUE LEVEL, también están disponibles desde hace tiempo los implantes Bone Level para la restauración al nivel óseo. Estos implantes ofrecen un enfoque más flexible para permitir un perfil de emergencia más natural, y con ellos es posible lograr unos mejores resultados estéticos.


Los pilares de cicatrización en distintos diámetros crean un perfil de emergencia muy natural, ofreciendo así una alta flexibilidad especialmente en el sector anterior. Los implantes Bone Level son más fáciles de cubrir en los procedimientos quirúrgicos en dos fases, así como en los casos de una estabilidad primaria deficiente o en la regeneración ósea guiada (ROG). El implante Bone Level está disponible en dos versiones: cilíndrica y cónica (BLT).



As pontas da Broca helicoidal Ø 2.2/2.8 mm têm um sobrecomprimento apical (até 0.4 mm) em comparação com a profundidade de inserção do implante.

Le punte delle frese a spirale Ø 2.2/2.8 mm presentano una lunghezza extra apicale (fino a 0.4 mm) rispetto alla profondità di inserimento dell'impianto.



Las puntas de las fresas helicoidales Ø 2.2/2.8 mm tienen una sobrelongitud apical (hasta 0.4 mm) en comparación con la profundidad de inserción del implante.



As pontas da Broca helicoidal BLT têm um sobrecomprimento apical em comparação com a profundidade de inserção do implante.

Le punte delle frese a spirale BLT presentano una lunghezza extra apicale rispetto alla profondità di inserimento dell'impianto.

Las puntas de las fresas helicoidales BLT tienen una sobrelongitud apical en comparación con la profundidad de inserción del implante.

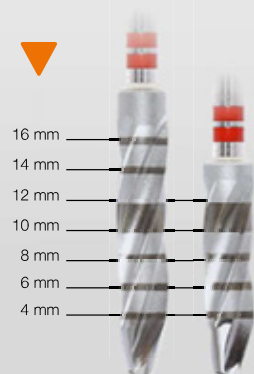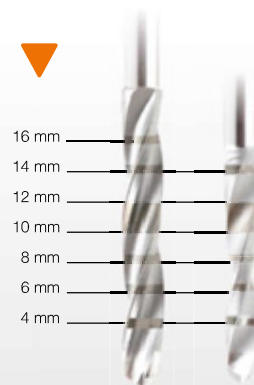

























BONE LEVEL · RESTAURAÇÕES | INDICAZIONI | RESTAURACIONES

Ø mm		Comprimento Lunghezza Longitudud	Coroa individual Corona singola Corona unitaria	Telescópio Telescopio Telescopio			Barra Barra Barra			Ponte Ponte Puente			ALLIGATOR
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3.3	NC	STANDARD	8		✓ ²⁾	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
			10		✓ ²⁾	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
			12		✓ ²⁾	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
			14		✓ ²⁾	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
	BLT	8		✓ ²⁾	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
		10		✓ ²⁾	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
		12		✓ ²⁾	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
		14		✓ ²⁾	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
	ROX-CERA	8			✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		10		✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		12		✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.75	STANDARD	8		✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		10		✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		12		✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	BLT	8		✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		10		✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		12		✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	4.1	STANDARD	8		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			10		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			12		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			14		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BLT		8		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		10		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		12		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		14		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ROX-CERA		8		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		10		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		12		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.8	STANDARD	8		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		10		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		12		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		14		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	BLT	8		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		10		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		12		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NOTA 1) Não se recomenda uma inserção na região molar
L'inserimento nella regione dei molari è sconsigliata
No se recomienda la inserción en la región de los molares

2) Restauração sobre 4 implantes com telescópio ou ALLIGATOR
Restauro su 4 impianti con telescopia o ALLIGATOR
Restauración sobre 4 implantes con telescopio o ALLIGATOR

22009		BL NC Implante	parafuso de fecho estéril 22014 incl.	Ø 3.3 mm		L 8.0 mm
22010		BL NC Implante	vite di chiusura sterile 22014 incl.			L 10.0 mm
22011		BL NC Implante	tornillo de cierre estéril 22014 incl.			L 12.0 mm
22012						L 14.0 mm
22050		BL NC Implante	parafuso de fecho estéril 22014 incl.	Ø 3.75 mm		L 8.0 mm
22051		BL NC Implante	vite di chiusura sterile 22014 incl.			L 10.0 mm
22052		BL NC Implante	tornillo de cierre estéril 22014 incl.			L 12.0 mm
23001		BLT NC Implante	parafuso de fecho estéril 22014 incl.	Ø 3.3 mm		L 8.0 mm
23002		BLT NC Implante	vite di chiusura sterile 22014 incl.			L 10.0 mm
23003		BLT NC Implante	tornillo de cierre estéril 22014 incl.			L 12.0 mm
23004						L 14.0 mm
23005		BLT NC Implante	parafuso de fecho estéril 22014 incl.	Ø 3.75 mm		L 8.0 mm
23006		BLT NC Implante	vite di chiusura sterile 22014 incl.			L 10.0 mm
23007		BLT NC Implante	tornillo de cierre estéril 22014 incl.			L 12.0 mm
22013		BL NC Parafuso de fecho				GH 0.0 mm
		BL NC Vite di chiusura				
22014		BL NC Tornillo de cierre				GH 0.5 mm
22200		BL NC Implante ROX-CERA	parafuso de fecho estéril 22014R incl.	Ø 3.3 mm		L 8.0 mm
22201		BL NC Implante ROX-CERA	vite di chiusura sterile 22014R incl.			L 10.0 mm
22202		BL NC Implante ROX-CERA	tornillo de cierre estéril 22014R incl.			L 12.0 mm
22014R		BL NC Parafuso de fecho BL NC Vite di chiusura BL NC Tornillo de cierre	com revestimento Cerid® 45 ON con revestimento Cerid® 45 ON con revestimento Cerid® 45 ON			GH 0.5 mm
22001		BL RC Implante	parafuso de fecho estéril 22099 incl.	Ø 4.1 mm		L 8.0 mm
22002		BL RC Implante	vite di chiusura sterile 22099 incl.			L 10.0 mm
22003		BL RC Implante	tornillo de cierre estéril 22099 incl.			L 12.0 mm
22004						L 14.0 mm
22005		BL RC Implante	parafuso de fecho estéril 22099 incl.	Ø 4.8 mm		L 8.0 mm
22006		BL RC Implante	vite di chiusura sterile 22099 incl.			L 10.0 mm
22007		BL RC Implante	tornillo de cierre estéril 22099 incl.			L 12.0 mm
22008						L 14.0 mm
24001		BLT RC Implante	parafuso de fecho estéril 22099 incl.	Ø 4.1 mm		L 8.0 mm
24002		BLT RC Implante	vite di chiusura sterile 22099 incl.			L 10.0 mm
24003		BLT RC Implante	tornillo de cierre estéril 22099 incl.			L 12.0 mm
24004						L 14.0 mm
24005		BLT RC Implante	parafuso de fecho estéril 22099 incl.	Ø 4.8 mm		L 8.0 mm
24006		BLT RC Implante	vite di chiusura sterile 22099 incl.			L 10.0 mm
24007		BLT RC Implante	tornillo de cierre estéril 22099 incl.			L 12.0 mm
22098		BL RC Parafuso de fecho				GH 0.0 mm
		BL RC Vite di chiusura				
22099		BL RC Tornillo de cierre				GH 0.5 mm
22060		BL RC Implante ROX-CERA	parafuso de fecho estéril 22099R incl.	Ø 4.1 mm		L 8.0 mm
22061		BL RC Implante ROX-CERA	vite di chiusura sterile 22099R incl.			L 10.0 mm
22062		BL RC Implante ROX-CERA	tornillo de cierre estéril 22099R incl.			L 12.0 mm
22099R		BL RC Parafuso de fecho BL RC Vite di chiusura BL RC Tornillo de cierre	com revestimento Cerid® 45 ON con revestimento Cerid® 45 ON con revestimento Cerid® 45 ON			GH 0.5 mm


BONE LEVEL · DIMENSÕES | DIMENSIONI | DIMENSIONES

BONE LEVEL NC Ø 3.3 mm

STANDARD



BLT




ROX-CERA




BONE LEVEL NC Ø 3.75 mm

STANDARD




BLT



BONE LEVEL RC Ø 4.1 mm

STANDARD



BLT




ROX-CERA



BONE LEVEL RC Ø 4.8 mm



STANDARD



BLT



* APICAL Ø | APICALE Ø | APICAL Ø




	STANDARD	BLT	ROX-CERA
 Ø mm	2.8	~1.9	2.8
 Ø mm	3.25	~2.3	
 Ø mm	3.5	~2.7	3.5
 Ø mm	4.2	~3.3	

* * sem rosca | **senza filettatura** | sin rosca

▶ PILARES DE CICATRIZAÇÃO | ABUTMENT DI GUARIGIONE | PILARES DE CICATRIZACIÓN

BL NC	22014	22014R*	22013
Parafusos de fecho Viti di chiusura Tornillo de cierre			
	GH 0.5 mm	GH 0.5 mm	GH 0.0 mm

BL NC	22017	22018*	22019	
Pilares de cicatrizaç�o Abutment di guarigione Pilares de cicatrizaç�on	Ø 3.6 mm			
	Ø 4.8 mm			
	Ø 5.5 mm			
	GH 2.0 mm	GH 3.5 mm	GH 5.0 mm	

BL RC	22099	22099R*	22098
Parafusos de fecho Viti di chiusura Tornillo de cierre			
	GH 0.5 mm	GH 0.5 mm	GH 0.0 mm


BL RC	22090	22091*	22092	
Pilar de cicatrizaç�o Abutment di guarigione Pilares de cicatrizaç�on	Ø 5.0 mm			
	Ø 6.5 mm			
	Ø 7.0 mm			
	GH 2.0 mm	GH 4.0 mm	GH 6.0 mm	

BONE LEVEL SURGERY


* Revestimento ROX-CERA Cerid® 45 ON a pedido | Rivestimento ROX-CERA Cerid® 45 ON su richiesta | Revestimiento ROX-CERA Cerid® 45 ON previa

BONE LEVEL NC · CIRURGIA | CHIRURGIA | CIRUGÍA


BONE LEVEL SURGERY

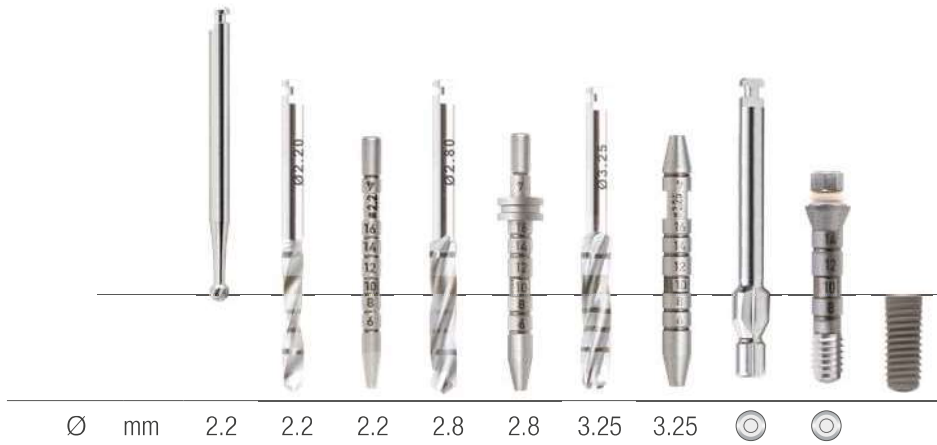


Representação exemplificativa do protocolo de perfuração | Illustrazione a titolo d'esempio dei protocolli di fresatura | Representación ilustrativa del protocolo de fresado

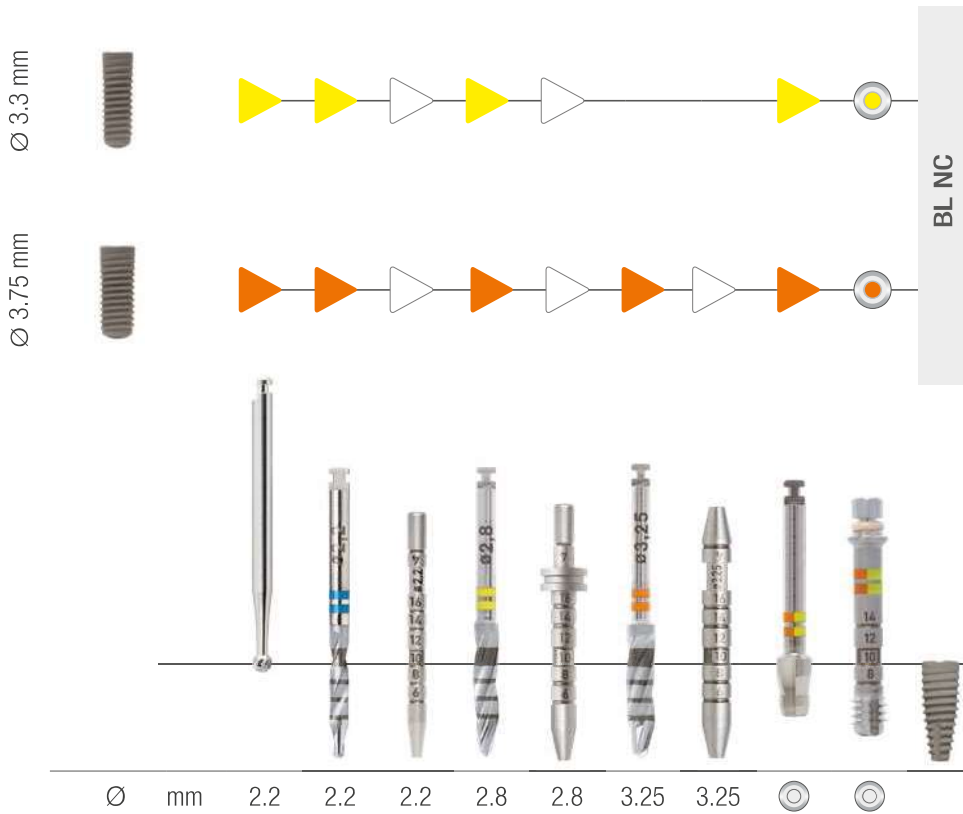

Representação exemplificativa do protocolo de perfuração | Illustrazione a titolo d'esempio dei protocolli di fresatura | Representación ilustrativa del protocolo de fresado

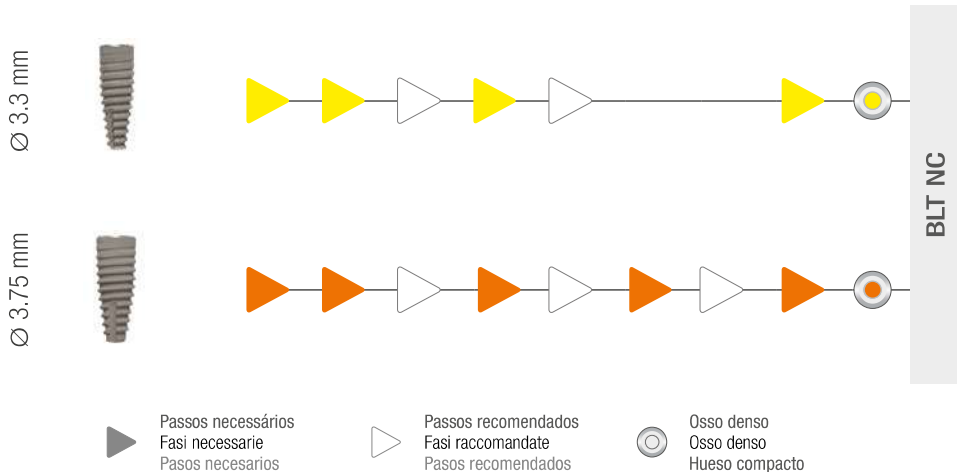

▶ BONE LEVEL RC · CIRURGIA | CHIRURGIA | CIRUGÍA

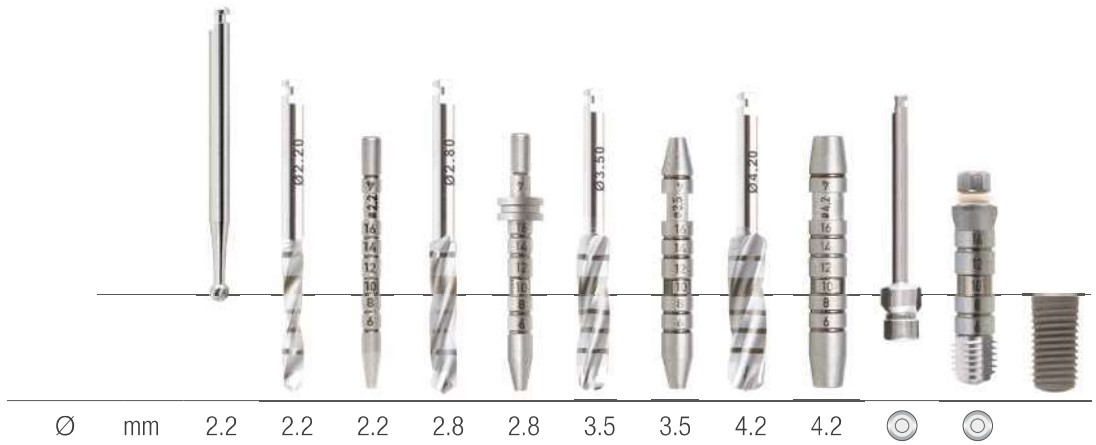

Representação exemplificativa do protocolo de perfuração | Illustrazione a titolo d'esempio dei protocolli di fresatura | Representación ilustrativa del protocolo de fresado

Ø 4.1 mm



Ø 4.8 mm



BL RC



Representação exemplificativa do protocolo de perfuração | Illustrazione a titolo d'esempio dei protocolli di fresatura | Representación ilustrativa del protocolo de fresado

Ø 4.1 mm



Ø 4.8 mm


























BLT RC

▶ Passos necessários
Fasi necessarie
Pasos necesarios



























◁ Passos recomendados
Fasi raccomandate
Pasos recomendados

○ Osso denso
Osso denso
Hueso compacto

BONE LEVEL · INSTRUMENTE | STRUMENTI | INSTRUMENTOS

31061	 TL/BL Broca esférica TL/BL Fresa a rosetta TL/BL Fresa de bola	Ø 2.2 mm		L 34.0 mm
11594	 TL/BL Broca piloto TL/BL Fresa piloto TL/BL Fresa piloto	Ø 1.54 mm		L 33.0 mm
38120	 TL/BL Broca helicoidal TL/BL Fresa spirale	Ø 2.2 mm		L 33.0 mm
38121	TL/BL Fresa helicoidal			L 41.0 mm
38149	 TL/BL Broca helicoidal TL/BL Fresa spirale	Ø 2.8 mm		L 33.0 mm
38148	TL/BL Fresa helicoidal			L 41.0 mm
38130	 TL/BL Broca helicoidal TL/BL Fresa spirale	Ø 3.25 mm		L 33.0 mm
38131	TL/BL Fresa helicoidal			L 41.0 mm
38135	 TL/BL Broca helicoidal TL/BL Fresa spirale	Ø 3.5 mm		L 33.0 mm
38136	TL/BL Fresa helicoidal			L 41.0 mm
38151	 TL/BL Broca helicoidal TL/BL Fresa spirale	Ø 4.2 mm		L 33.0 mm
38152	TL/BL Fresa helicoidal			L 41.0 mm
22136	 BL NC Broca de perfil BL NC Fresa svasata	Ø 3.3 mm		L 26.0 mm
22137	BL NC Fresa de perfil			L 35.0 mm
22139	 BL NC Broca de perfil BL NC Fresa svasata	Ø 3.75 mm		L 26.0 mm
22140	BL NC Fresa de perfil			L 35.0 mm
22111	 BL RC Broca de perfil BL RC Fresa svasata	Ø 4.1 mm		L 26.0 mm
22113	BL RC Fresa de perfil			L 35.0 mm
22114	 BL RC Broca de perfil BL RC Fresa svasata	Ø 4.8 mm		L 26.0 mm
22112	BL RC Fresa de perfil			L 35.0 mm
22138	 BL NC Promotor de rosca BL NC Maschiatore BL NC Macho de rosca	Ø 3.3 mm		L 23.0 mm
95263	 BL NC Promotor de rosca BL NC Maschiatore BL NC Macho de rosca	Ø 3.75 mm		L 23.0 mm
95264	 BL RC Promotor de rosca BL RC Maschiatore BL RC Macho de rosca	Ø 4.1 mm		L 23.0 mm
95269	 BL RC Promotor de rosca BL RC Maschiatore BL RC Macho de rosca	Ø 4.8 mm		L 23.0 mm

▶ BONE LEVEL TAPERED · INSTRUMENTOS | STRUMENTI | INSTRUMENTOS

24010		BLT NC/RC Broca helicoidal BLT NC/RC Fresa spirale	Ø 2.2 mm		L 33.0 mm
24011		BLT NC/RC Fresa helicoidal			L 41.0 mm
24012		BLT NC/RC Broca helicoidal BLT NC/RC Fresa spirale	Ø 2.8 mm		L 33.0 mm
24013		BLT NC/RC Fresa helicoidal			L 41.0 mm
24014		BLT NC Broca helicoidal BLT NC Fresa spirale	Ø 3.25 mm		L 33.0 mm
24015		BLT NC Fresa helicoidal			L 41.0 mm
24016		BLT RC Broca helicoidal BLT RC Fresa spirale	Ø 3.5 mm		L 33.0 mm
24017		BLT RC Fresa helicoidal			L 41.0 mm
24021		BLT RC Broca helicoidal BLT RC Fresa spirale	Ø 4.2 mm		L 33.0 mm
24022		BLT RC Fresa helicoidal			L 41.0 mm
23016		BLT NC Broca de perfil BLT NC Fresa svasata	Ø 3.3 mm		L 25.0 mm
23017		BLT NC Fresa de perfil			L 33.0 mm
23018		BLT NC Broca de perfil BLT NC Fresa svasata	Ø 3.75 mm		L 25.0 mm
23019		BLT NC Fresa de perfil			L 33.0 mm
24019		BLT RC Broca de perfil BLT RC Fresa svasata	Ø 4.1 mm		L 25.0 mm
24018		BLT RC Fresa de perfil			L 33.0 mm
24023		BLT RC Broca de perfil BLT RC Fresa svasata	Ø 4.8 mm		L 25.0 mm
24024		BLT RC Fresa de perfil			L 33.0 mm
23020		BLT NC Promotor de rosca BLT NC Maschiatore BLT NC Macho de rosca	Ø 3.3 mm		L 25.0 mm
23021		BLT NC Promotor de rosca BLT NC Maschiatore BLT NC Macho de rosca	Ø 3.75 mm		L 25.0 mm
24020		BLT RC Promotor de rosca BLT RC Maschiatore BLT RC Macho de rosca	Ø 4.1 mm		L 25.0 mm
24025		BLT RC Promotor de rosca BLT RC Maschiatore BLT RC Macho de rosca	Ø 4.8 mm		L 25.0 mm
64566		OKTAGON® Guia de Paralelização OKTAGON® Guida di parallelismo OKTAGON® Guía de paralelización	Ø 2.2 mm		2 un. 2 pz. 2 uu. L 27.0 mm
64567		OKTAGON® Calibrador de profundidade com indicador de distância OKTAGON® Misuratore di profondità con indicatore di distanza OKTAGON® Calibrador de profundidad con indicador de distancia	Ø 2.2/2.8 mm		L 27.0 mm
64568		OKTAGON® Calibrador de profundidade OKTAGON® Misuratore di profondità OKTAGON® Calibrador de profundidad	Ø 3.25 mm		L 27.0 mm
64569		OKTAGON® Calibrador de profundidade OKTAGON® Misuratore di profondità OKTAGON® Calibrador de profundidad	Ø 3.5 mm		L 27.0 mm
64570		OKTAGON® Calibrador de profundidade OKTAGON® Misuratore di profondità OKTAGON® Calibrador de profundidad	Ø 4.2 mm		L 27.0 mm

OKTAGON®

TISSUE LEVEL

PROTÉTICA







PROTESI

PRÓTESIS














▶ TISSUE LEVEL RP · PROTÉTICA | PROTESI | PRÓTESIS

IMPRESSÃO | IMPRONTA | PRISE D'EMPREINTE

31156		TL RP Espigão de impressão com parafuso de posicionamento integrado para procedimento de impressão com moldeira aberta	
		TL RP Transfer da impronta con vite di posizionamento integrata	per presa d'impronta aperta
		TL RP Poste de impresión con tornillo de posicionamiento	para la toma de impresión abierta
31159		TL RP/WP Parafuso de posicionamento para espigão de impressão	L 25 mm
		TL RP/WP Vite di posizionamento per transfer da impronta	
		TL RP/WP Tornillo de posicionamiento para poste de impresión	
31158		TL RP Espigão de impressão com parafuso de posicionamento integrado para procedimento de impressão com moldeira fechada	
		TL RP Transfer da impronta con vite di posizionamento integrata	per presa d'impronta chiusa
		TL RP Poste de impresión con tornillo de posicionamiento	para la toma de impresión cerrada
55283		TL RP Tampa de impressão (snap-on)	
		TL RP Cappetta per impronta (snap-on)	
		TL RP Cofia de impresión (snap-on)	
84957		TL RP Cilindro de posicionamento	
		TL RP Cilindro di posizionamento	
		TL RP Cilindro de posicionamiento	
31157		TL RP Análogo de implante	
		TL RP Analogo d'implianto	
		TL RP Análogo de implante	

TISSUE LEVEL RP · PROTÉTICA | PROTESI | PRÓTESIS

CIMENTÁVEL | CEMENTABILI | CEMENTABLE

31161		TL RP Pilar parafuso base integrado	cimentável	cónico	∠ 0°	H 5.5 mm
		TL RP Abutment con vite di base integrata	cementabili	conico		
		TL RP Pilar incl. tornillo de base	cementable	cónico		
38118		TL RP Pilar com parafuso base integrado	cimentável	paralelo	∠ 15° A	H 6.7 mm
		TL RP Abutment con vite di base integrata	cementabili	parallelo		
38117		TL RP Pilar con tornillo de base integrado	cementable	paralelo	∠ 15° B	H 6.7 mm
38122		TL RP Pilar com parafuso base integrado	cimentável	cónico	∠ 15° A	H 6.5 mm
		TL RP Abutment con vite di base integrada	cementabili	conico		
38123		TL RP Pilar con tornillo de base integrado	cementable	cónico	∠ 15° B	H 6.5 mm
38124		TL RP Pilar com parafuso base integrado	cimentável	cónico	∠ 20° A	H 6.5 mm
		TL RP Abutment con vite di base integrada	cementabili	conico		
38125		TL RP Pilar con tornillo de base integrado	cementable	cónico	∠ 20° B	H 6.5 mm
38140		TL RP Pilar provisório com bloqueio contra rotação, incl. parafuso				H 12.0 mm
		TL RP Abutment provvisorio con ingaggio, incl. vite				
		TL RP Pilar provisional con protección antirrotacional, incl. tornillo				
31163		TL RP Tampa de plástico calcinável para 31161		Coroa		
		TL RP Cappetta in resina calcinabile per 31161		Corona		
		TL RP Cofia de plástico calcinable para 31161		Corona		
31162		TL RP Tampa de plástico calcinável para 31161		Ponte/Barra		
		TL RP Cappetta in resina calcinabile per 31161		Ponte/Barra		
		TL RP Cofia de plástico calcinable para 31161		Puente/Barra		
82689		TL RP Ombro de plástico para pilares 15°/20°				
		TL RP Spalla in resina per abutment 15°/20°				
		TL RP Hombro de plástico para pilares de 15°/20°				

∠ PILARES | ∠ ABUTMENT | ∠ PILARES

VERSION A + B

Angulado acima da aresta do octógono, marcado com um ponto.

Angolazione sul bordo dell'ottagono, contrassegnata da un punto.

Angulación por encima del vértice del octógono, marcada con un punto.

Angulado acima da superfície do octógono, marcado com dois pontos.














Angolazione sulla superficie dell'ottagono, contrassegnata da due punti.

Angulación por encima de la superficie del octógono, marcada con dos puntos.













TISSUE LEVEL RP · PROTÉTICA | PROTESI | PRÓTESIS

CIMENTÁVEL | CEMENTABILI | CEMENTABLE








55283		TL RP Tampa de impressão (snap-on) TL RP Cappetta per impronta (snap-on) TL RP Cofia de impresión (snap-on)			
55288		TL RP Cilindro de posicionamento TL RP Cilindro di posizionamento TL RP Cilindro de posicionamiento		amarelo gialla amarillo	
55299		TL RP Cilindro de posicionamento TL RP Cilindro di posizionamento TL RP Cilindro de posicionamiento		cinzento grigio gris	
55394		TL RP Cilindro de posicionamento TL RP Cilindro di posizionamento TL RP Cilindro de posicionamiento		azul blu azul	
55396		TL RP Análogo para pilar sólido TL RP Analogo per abutment solido TL RP Análogo para pilar macizo		amarelo gialla amarillo	
55397		TL RP Análogo para pilar sólido TL RP Analogo per abutment solido TL RP Análogo para pilar macizo		cinzento grigio gris	
55400		TL RP Análogo para pilar sólido TL RP Analogo per abutment solido TL RP Análogo para pilar macizo		azul blu azul	
81038		TL RP Pilar sólido cone 6° TL RP Abutment solido cono 6° TL RP Pilar macizo cono 6°		amarelo gialla amarillo	H 4.0 mm
81083		TL RP Pilar sólido cone 6° TL RP Abutment solido cono 6° TL RP Pilar macizo cono 6°		cinzento grigio gris	H 5.5 mm
81096		TL RP Pilar sólido cone 6° TL RP Abutment solido cono 6° TL RP Pilar macizo cono 6°		azul blu azul	H 7.0 mm
55487		TL RP Tampa de plástico calcinável TL RP Cappetta in resina calcinabile TL RP Coiffe en plastique, calcinable		Coroa Corona Corona	
55478		TL RP Tampa de plástico calcinável TL RP Cappetta in resina calcinabile TL RP Coiffe en plastique, calcinable		Ponte/Barra Ponte/Barra Puente/Barra	
72089		TL RP Chave de enroscar para pilar sólido TL RP Insetitore per Abutment solido TL RP Instrumento de inserción para pilar macizo			L 18.0 mm

TISSUE LEVEL RP · PROTÉTICA | PROTESI | PRÓTESIS

APARAFUSÁVEL | AVVITABILE | ATORNILLABLE








31164		TL RP Pilar com parafuso base integrado TL RP Abutment con vite di base integrata TL RP Pilar con tornillo de base integrado	aparafusável avvitabile atornillable		≈ 0°	H 1.5 mm
82648		TL RP Pilar com parafuso base integrado TL RP Abutment con vite di base integrada	aparafusável avvitabile	cónico conico	≈ 15° A	H 6.5 mm
82649		TL RP Pilar con tornillo de base integrado	atornillable	cónico	≈ 15° B	H 6.5 mm
38119		TL RP Pilar com parafuso base integrado TL RP Abutment con vite di base integrada	aparafusável avvitabile	cónico conico	≈ 20° A	H 5.5 mm
38116		TL RP Pilar con tornillo de base integrado	atornillable	cónico	≈ 20° B	H 5.5 mm
31166		TL RP Tampa de plástico calcinável para 31164 TL RP Cappetta in resina calcinabile per 31164 TL RP Cofia de plástico calcinable para 31164		Coroa Corona Corona		
31165		TL RP Tampa de plástico calcinável para 31164 TL RP Cappetta in resina calcinabile per 31164 TL RP Cofia de plástico calcinable para 31164		Ponte/Barra Ponte/Barra Puente/Barra		
31160		TL RP/WP Parafuso oclusal TL RP/WP Vite oclusale TL RP/WP Tornillo oclusal				L 4.5 mm
38126		TL RP Tampa de titânio incl. parafuso base 57048 TL RP Cappetta in titanio incl. vite di base TL RP Cofia de titanio incl. tornillo de base 57048		Barra Barra Barra	≈ 0°	H 10.0 mm
57048		TL RP Parafuso base TL RP Vite di base TL RP Tornillo de base	também indicado para CAD/CAM idonea anche per CAD/CAM también indicado para CAD/CAM			L 6.7 mm

BASES ADESIVAS DE TITÂNIO | BASI ADESIVE IN TITANIO | BASES ADHESIVAS DE TITANIO












57050		TL RP Base adesiva de titânio com bloqueio contra rotação incl. 31167 e 31025 TL RP Base adesiva in titanio con ingaggio, incl. 31167 e 31025 TL RP Bases adhesivas de titanio con protección antirrotacional, incl. 31167 y 31025	paralelo parallelo paralelo		≈ 15°	Ø 3.5 mm	H 5.5 mm
31167		TL/BL Manga de plástico calcinável TL/BL Cappetta in resina calcinabile TL/BL Casquillo de plástico calcinable					H 11.0 mm
77104		TL RP Base adesiva de titânio IL, com bloqueio contra rotação, incl. tampa de plástico e parafuso TL RP Base adesiva in titanio IL, con ingaggio, incl. cappetta in resina e vite TL RP Base adhesiva de titanio IL, con protección antirrotacional, incl. cofia de plástico y tornillo		Coroa Corona Corona		Ø 5.0 mm	H 4.9 mm
77105		TL RP Base adesiva de titânio AL, com bloqueio contra rotação para 31164 incl. tampa de plástico e parafuso TL RP Base adesiva in titanio AL, con ingaggio per 31164, incl. cappetta in resina e vite TL RP Base adhesiva de titanio AL, con protección antirrotacional para 31164, incl. cofia de plástico y tornillo		Coroa Corona Corona		Ø 5.0 mm	H 4.7 mm
77106		TL RP Base adesiva de titânio IL, sem bloqueio contra rotação, incl. tampa de plástico e parafuso TL RP Base adesiva in titanio IL, senza ingaggio, incl. cappetta in resina e vite TL RP Base adhesiva de titanio IL, sin protección antirrotacional, incl. cofia de plástico y tornillo		Ponte Ponte Puente		Ø 5.0 mm	H 4.9 mm
77107		TL RP Base adesiva de titânio AL, sem bloqueio contra rotação para 31164 incl. tampa de plástico e parafuso TL RP Base adesiva in titanio AL, senza ingaggio per 31164, incl. cappetta in resina e vite TL RP Base adhesiva de titanio IL, sin protección antirrotacional, para 31164, incl. cofia de plástico y tornillo		Ponte Ponte Puente		Ø 5.0 mm	H 4.7 mm
31025		TL RP/WP Parafuso base TL RP/WP Vite di base TL RP/WP Tornillo de base					L 7.6 mm

TISSUE LEVEL RP · PROTÉTICA | PROTESI | PRÓTESIS

HÍBRIDO | IBRIDA | HIBRIDO

38087		TL RP Encaixes esféricos retentivos TL RP Ancoraggio a sfera TL RP Anclaje de bola retentivo										GH 0.0 mm
38071		TL RP Análogo de implantes para encaixes esféricos retentivos TL RP Analogo d'impianto per ancoraggio a sfera TL RP Matriz para anclaje de bola (incl. todas las juntas tóricas)										
82758		TL RP Matrizes para encaixes esféricos retentivos TL RP Matrice per ancoraggio a sfera TL RP Matriz para anclaje de bola										(incl. todos os o-rings) (incl. tutti gli O-ring) (incl. todas las juntas tóricas)
89615		TL RP O-Ring 70 shore TL RP O-ring 70 shore TL RP Junta tórica 70 shore	vermelho rosso roja	Força de retenção Forza di ritenzione Fuerza de retención	ligeira bassa ligera	4 un. 4 pz. 4 uu.						
89616		TL RP O-Ring 80 shore TL RP O-ring 80 shore TL RP Junta tórica 80 shore	azul blu azul	Força de retenção Forza di ritenzione Fuerza de retención	média media media	4 un. 4 pz. 4 uu.						
89617		TL RP O-Ring 90 shore TL RP O-ring 90 shore TL RP Junta tórica 90 shore	preto nero negro	Força de retenção Forza di ritenzione Fuerza de retención	forte alta fuerte	4 un. 4 pz. 4 uu.						
38073		TL RP Chave de enroscar para encaixes esféricos retentivos TL RP Insetitore per ancoraggio a sfera TL RP Instrumento de inserción para anclaje de bola										L 22.0 mm

HÍBRIDO | IBRIDA | HIBRIDO

98001		TL RP ALLIGATOR Pilar			∠ 0°	GH 1.0 mm						
98002		TL RP ALLIGATOR Abutment				GH 2.0 mm						
98003		TL RP ALLIGATOR Pilar				GH 3.0 mm						
98004		TL RP ALLIGATOR Pilar, parafuso base incl. 98009				GH 4.0 mm						
98007		TL RP ALLIGATOR Abutment, incl. vite di base 98009			∠ 15°	GH 1.5 mm						
98008		TL RP ALLIGATOR Pilar, tornillo de base 98009 incl.				GH 3.0 mm						
98009		TL RP ALLIGATOR Parafuso base TL RP ALLIGATOR Vite di base TL RP ALLIGATOR Tornillo de base				L 8.0 mm						
75836		ALLIGATOR Ponta de chave de encaixar para roquete ALLIGATOR Strumento di inserimento per cricchetto ALLIGATOR Instrumento auxiliar de inserción para carraca				L 15.0 mm						
63978		OKTAGON® Chave de parafusos uma peça				L 18.0 mm						
64551		OKTAGON® Cacciavite monopezzo				L 24.0 mm						
64553		OKTAGON® Destornillador una pieza				L 30.0 mm						

OKTAGON®

TISSUE LEVEL

HÍBRIDO

















IBRIDA

HIBRIDO










TISSUE LEVEL RP · PROTÉTICA | PROTESI | PRÓTESIS

ALLIGATOR HÍBRIDO | ALLIGATOR IBRIDA | ALLIGATOR HIBRIDO

16040		Tampa de transferência Transfer da impronta Cofia de transferencia				4 un. 4 pz. 4 uu.
16041		Análogo do modelo Analogo da laboratorio Implante de laboratorio				4 un. 4 pz. 4 uu.
16010		Pacote de processamento de matrizes para angulação (divergência 0° a 20°) incl. inserto de montagem preto, colar de montagem e insertos de retenção em amarelo, rosa-choque, transparente, lilás Confezione di trattamento con matrice per angolazione ridotta (divergenza da 0° a 20°) incl. inserto di montaggio nero, dischetto protettivo e inserti di ritenzione gialli, rosa, trasparente, viola Paquete de procesado de matrices para corrección de la angulación (divergencia entre 0° a 20°) incl. aditamento de montaje negro, collar de montaje y aditamentos retentivos amarillo, rosa, transparente, violeta				
16011		Inserto de retenção para angulação Inserto di ritenzione per angolazione ridotta Aditamento retentivo para angulación	amarelo gialla amarillo	Força de retenção Forza di ritenzione Fuerza de retención	0.7 kg	4 un. 4 pz. 4 uu.
16012		Inserto de retenção para angulação Inserto di ritenzione per angolazione ridotta Aditamento retentivo para angulación	rosa-choque rosa rosa	Força de retenção Forza di ritenzione Fuerza de retención	0.9 kg	4 un. 4 pz. 4 uu.
16013		Inserto de retenção para angulação Inserto di ritenzione per angolazione ridotta Aditamento retentivo para angulación	transparente trasparente transparente	Força de retenção Forza di ritenzione Fuerza de retención	1.5 kg	4 un. 4 pz. 4 uu.
16014		Inserto de retenção para angulação Inserto di ritenzione per angolazione ridotta Aditamento retentivo para angulación	lilás viola violeta	Força de retenção Forza di ritenzione Fuerza de retención	1.8 kg	4 un. 4 pz. 4 uu.
16021		Pacote de processamento de matrizes para angulação alargada (divergência 0° a 40°) incl. inserto de montagem preto, colar de montagem e insertos de retenção em amarelo, rosa-choque, transparente, lilás Confezione di trattamento con matrice per angolazione estesa (divergenza da 0° a 40°) incl. inserto di montaggio nero, dischetto protettivo e inserti di ritenzione gialli, rosa, trasparente, viola Paquete de procesado de matrices para corrección de la angulación ampliada (divergencia entre 0° a 40°) incl. aditamento de montaje negro, collar de montaje y aditamentos retentivos amarillo, rosa, transparente, violeta				
16022		Inserto de retenção para angulação alargada Inserto di ritenzione per angolazione estesa Aditamento retentivo para angulación ampliada	amarelo gialla amarillo	Força de retenção Forza di ritenzione Fuerza de retención	0.6 kg	4 un. 4 pz. 4 uu.
16023		Inserto de retenção para angulação alargada Inserto di ritenzione per angolazione estesa Aditamento retentivo para angulación ampliada	rosa-choque rosa rosa	Força de retenção Forza di ritenzione Fuerza de retención	0.8 kg	4 un. 4 pz. 4 uu.
16024		Inserto de retenção para angulação alargada Inserto di ritenzione per angolazione estesa Aditamento retentivo para angulación ampliada	transparente trasparente transparente	Força de retenção Forza di ritenzione Fuerza de retención	1.0 kg	4 un. 4 pz. 4 uu.
16025		Inserto de retenção para angulação alargada Inserto di ritenzione per angolazione estesa Aditamento retentivo para angulación ampliada	lilás viola violeta	Força de retenção Forza di ritenzione Fuerza de retención	1.5 kg	4 un. 4 pz. 4 uu.
16030		Invólucro de matriz de titânio Matrice in titanio Carcasa de matriz				2 un. 2 pz. 2 uu.
16035		Colar de montagem Dischetto protettivo Collar de montaje				10 un. 10 pz. 10 uu.
16042		Inserto de montagem Inserto di montaggio Collar de montaje	preto nero negro			4 un. 4 pz. 4 uu.
16050		Instrumento de montagem e desmontagem para insertos de retenção Inseritore/estrattore di inserti di ritenzione Instrumento para la colocación y la retirada de los aditamentos retentivos				

▶ TISSUE LEVEL RP · PROTÉTICA | PROTESI | PRÓTESIS

CAD/CAM | CAD/CAM | CAD/CAM

77100		TL RP Pilar para digitalização intraoral AL parafuso incluído TL RP Corpo di scansione per scansione intraorale AL incl. vite TL RP Cuerpo de referencia para AL intraoral incl. tornillo	
77101		TL RP Pilar para digitalização intraoral IL parafuso incluído TL RP Corpo di scansione per scansione intraorale IL incl. vite TL RP Cuerpo de referencia para IL intraoral incl. tornillo	
77102		TL RP Corpo de digitalização para scanner AL, sem parafuso 77601 TL RP Corpo di scansione per scanner da laboratorio AL senza vite 77601 TL RP Cuerpo de referencia para escáner AL, sin tornillo 77601	
77103		TL RP Corpo de digitalização para scanner IL, sem parafuso 77602 TL RP Corpo di scansione per scanner da laboratorio IL senza vite 77602 TL RP Cuerpo de referencia para escáner IL, sin tornillo 77602	
77109		TL RP Bloco de titânio pré-fresado IL incl. parafuso TL RP Blocco in titanio prefresato IL incl. vite TL RP Bloque de titanio prefresado IL incl. tornillo	
77601		TL RP/WP Parafuso para corpo de digitalização para scanner AL TL RP/WP Vite corpo di scansione per scanner AL TL RP/WP Tornillo para cuerpo de referencia para escáner AL	L 4.5 mm
77602		TL RP/WP Parafuso para corpo de digitalização para scanner IL TL RP/WP Vite corpo di scansione per scanner IL TL RP/WP Tornillo para cuerpo de referencia para escáner IL	L 6.7 mm

► SOLUÇÕES CAD/CAM | SOLUZIONI CAD/CAM | SOLUCIONES CAD/CAM

3shape

dental wings

exocad

Estão disponíveis as seguintes bibliotecas | Sono disponibili le seguenti librerie | Están disponibles las bibliotecas siguientes

SOLUÇÕES CAD/CAM ESTÉTICAS

A criação de peças protéticas (os chamados fabricos personalizados) com base nos dados disponibilizados para a restauração de implantes OKTAGON® é feita à responsabilidade do próprio e atendendo às exigências relevantes da diretiva „Dispositivos médicos“ 93/42/CEE. Desta forma, o fabricante é responsável pela qualidade (segurança de funcionamento, precisão de ajuste) dos produtos criados, bem como pelo respeito das exigências pertinentes da diretiva supracitada. Se, durante o fabrico e o fornecimento, forem lesados direitos de propriedade industrial de terceiros, a responsabilidade é do fabricante. A fim de garantir a qualidade das peças fabricadas, são fornecidos dados técnicos e informações atuais sobre a interface protética dos implantes OKTAGON®. Estes dados técnicos são informações confidenciais. Estes devem ser utilizados exclusivamente no quadro da restauração de implantes OKTAGON®. Estas informações não podem ser disponibilizadas a terceiros.

O fabricante compromete-se a prestar apoio técnico à DRS na avaliação de incidentes (quase-incidentes, informações sobre ferimentos de pessoas, etc.) e no caso de reclamações de clientes relacionadas com a utilização dos produtos fabricados, bem como a tomar conjuntamente medidas corretivas, como ações de recolha e ações corretivas posteriores, a definir, e a informar mutuamente. Os custos de implementação das medidas em causa serão suportados pela parte que causou o respetivo incidente ou dano.

Os dados de fresagem para a restauração CAD/CAM podem ser pedidos por e-mail para cadcam@meisingerimplants.com

SOLUZIONI ESTETICHE CAD/CAM

La realizzazione delle componenti protesiche (cosiddetti prodotti su misura) in base ai dati forniti per la protesizzazione di impianti OKTAGON® avviene sotto la propria responsabilità, tenendo conto dei requisiti applicabili della direttiva sui dispositivi medici 93/42/CEE. Il fabbricante è quindi responsabile della qualità (affidabilità, precisione dimensionale) dei prodotti realizzati, nonché del rispetto dei requisiti applicabili di cui alla direttiva sopra citata. L'eventuale violazione di diritti di proprietà di terzi durante la produzione e la consegna ricade sotto la responsabilità del fabbricante. Per garantire la qualità delle componenti realizzate, vengono forniti dati tecnici sempre aggiornati e informazioni riguardanti l'interfaccia protesica degli impianti OKTAGON®. Tali dati tecnici sono informazioni riservate e devono essere utilizzati esclusivamente per la protesizzazione di impianti OKTAGON®. Queste informazioni non devono essere divulgate a terzi.

Il fabbricante si impegna a fornire supporto tecnico a DRS nella valutazione di eventuali incidenti (quasi-incidenti, informazioni su lesioni personali, ecc.) e di reclami di clienti riguardanti l'impiego dei prodotti realizzati, nonché a stabilire ed ad adottare congiuntamente misure correttive, tra cui azioni di richiamo e ulteriori azioni correttive, così come a fornire reciprocamente tutte le informazioni a riguardo. I costi per l'implementazione delle corrispondenti misure sono a carico della parte contraente che ha causato l'evento o il danno in questione.

I dati di fresatura per il restauro CAD/CAM possono essere richiesti via e-mail all'indirizzo cadcam@meisingerimplants.com

SOLUCIONES CAD/CAM ESTÉTICAS







La fabricación de los componentes protésicos (los productos a medida) basados en los datos facilitados para la restauración de los implantes OKTAGON® se efectúa bajo su propia responsabilidad teniendo en cuenta los requisitos pertinentes de la Directiva sobre productos sanitarios 93/42/CEE. Esto significa que el fabricante es responsable de la calidad (funcionalidad, ajuste) de los productos fabricados y del cumplimiento de los correspondientes requisitos de la directiva mencionada. En el caso de que durante la fabricación y la entrega se violen derechos de propiedad intelectual de terceros, el fabricante será el único responsable de ello. A fin de permitir la calidad de los componentes fabricados se pondrán a disposición los datos técnicos actuales y la información sobre la conexión protésica de los implantes OKTAGON®. Estos datos técnicos son informaciones confidenciales. Solo está permitida su utilización en el marco de la restauración de los implantes OKTAGON®. Esta información no debe hacerse accesible a terceros.

El fabricante se compromete a proporcionar apoyo técnico a DRS para la evaluación de incidentes (cuasi-incidentes, información sobre lesiones en personas etc.) y de reclamaciones de clientes relacionadas con el uso de los productos fabricados, a emprender medidas correctivas conjuntas como, por ejemplo, retirada de productos y a definir, implementar e informar de otras acciones adicionales posteriores. Los costes para la implementación de las medidas correspondientes serán asumidos por la parte contratante que haya provocado el incidente o el siniestro.





Los datos del fresado para la restauración CAD/CAM se pueden solicitar por correo electrónico en la dirección cadcam@meisingerimplants.com

TISSUE LEVEL WP · PROTÉTICA | PROTESI | PRÓTESIS





IMPRESSÃO | IMPRONTA | TOMA DE IMPRESIÓN

93734		TL WP Espigão de impressão com parafuso de posicionamento integrado para procedimento de impressão com moldeira aberta TL WP Transfer da impronta con vite di posizionamento integrata per presa d'impronta aperta TL WP Poste de impresión con tornillo de posicionamiento para la toma de impresión abierta	
31159		TL RP/WP Parafuso de posicionamento para espigão de impressão TL RP/WP Vite di posizionamento per transfer da impronta TL RP/WP Tornillo de posicionamiento para poste de impresión	L 25 mm
93745		TL WP Espigão de impressão com parafuso de posicionamento integrado para procedimento de impressão com moldeira fechada TL WP Transfer da impronta con vite di posizionamento integrata per presa d'impronta chiusa TL WP Poste de impresión con tornillo de posicionamiento para la toma de impresión cerrada	
93735		TL WP Análogo de implante TL WP Analogo d'impianto TL WP Análogo de implante	
90503		TL WP Tampa de impressão (snap-on) TL WP Cappetta per impronta (snap-on) TL WP Cofia de impresión (snap-on)	
90504		TL WP Cilindro de posicionamento TL WP Cilindro di posizionamento TL WP Cilindro de posicionamiento	

CIMENTÁVEL | CEMENTABILI | CEMENTABLE



93736		TL WP Pilar, parafuso base incl. TL WP Abutment con vite di base integrata TL WP Pilar incl. tornillo de base	cimentável cementabili cementable	cónico conico cónico	$\neq 0^\circ$	H 5.5 mm
93739		TL WP Pilar com parafuso base integrado TL WP Abutment con vite di base integrada	cimentável cementabili	cónico conico	$\neq 15^\circ A$	H 5.7 mm
93737		TL WP Pilar com tornillo de base integrado	cementable	cónico	$\neq 15^\circ B$	
93750		TL WP Pilar provisório com bloqueio contra rotação, incl. parafuso TL WP Abutment provvisorio con ingaggio, incl. vite TL WP Pilar provisional con protección antirrotacional, incl. tornillo				H 12.0 mm

APARAFUSÁVEL | AVVITABILE | ATORNILLABLE







93720		TL WP Pilar com parafuso base integrado TL WP Abutment con vite di base integrada TL WP Pilar con tornillo de base integrado	aparafusável avvitabile atornillable		$\neq 0^\circ$	H 1.5 mm
93722		TL WP Tampa de plástico calcinável para 93720 TL WP Cappetta in resina calcinabile per 93720 TL WP Cofia de plástico calcinable para 93720		Coroa Corona Corona		
93721		TL WP Tampa de plástico calcinável para 93720 TL WP Cappetta in resina calcinabile per 93720 TL WP Cofia de plástico calcinable para 93720		Ponte/Barra Ponte/Barra Puente/Barra		
31160		TL RP/WP Parafuso oclusal TL RP/WP Vite occlusale TL RP/WP Tornillo oclusal				L 4.5 mm

TISSUE LEVEL WP · PROTÉTICA | PROTESI | PRÓTESIS

BASES ADESIVAS DE TITÂNIO | BASI ADESIVE IN TITANIO | BASES ADHESIVAS DE TITANIO

93718	 TL WP Base adesiva de titânio com bloqueio contra rotação incl. 31167 e 31025 TL WP Base adesiva in titanio con ingaggio, incl. 31167 e 31025 TL WP Bases adhesivas de titanio con protección antirrotacional, incl. 31167 y 31025	paralelo paralelo paralelo	∠ 15°	Ø 3.5 mm	H 5.5 mm
31167	 TL/BL Manga de plástico calcinável TL/BL Cappetta in resina calcinabile TL/BL Casquillo de plástico calcinable				H 11.0 mm
31025	 TL RP/WP Parafuso base TL RP/WP Vite di base TL RP/WP Tornillo de base				L 7.6 mm
77204	 TL WP Base adesiva de titânio IL, com bloqueio contra rotação, incl. tampa de plástico e parafuso TL WP Base adesiva in titanio IL, con ingaggio, incl. cappetta in resina e vite TL WP Base adhesiva de titanio IL, con protección antirrotacional, incl. cofia de plástico y tornillo		Coroa Corona Corona	Ø 6.8 mm	H 5.0 mm
77205	 TL WP Base adesiva de titânio AL, com bloqueio contra rotação para 93720, incl. tampa de plástico e parafuso TL WP Base adesiva in titanio AL, con ingaggio per 93720 incl. cappetta in resina e vite TL WP Base adhesiva de titanio AL, con protección antirrotacional para 93720, incl. cofia de plástico y tornillo		Coroa Corona Corona	Ø 6.8 mm	H 5.0 mm
77206	 TL WP Base adesiva de titânio IL, sem bloqueio contra rotação, incl. tampa de plástico e parafuso TL WP Base adesiva in titanio IL, senza ingaggio, incl. cappetta in resina e vite TL WP Base adhesiva de titanio IL, sin protección antirrotacional, incl. cofia de plástico y tornillo		Ponte Ponte Puente	Ø 6.8 mm	H 5.0 mm
77207	 TL WP Base adesiva de titânio AL, sem bloqueio contra rotação para 93720 incl. tampa de plástico e parafuso TL WP Base adesiva in titanio AL, senza ingaggio per 93720, incl. cappetta in resina e vite TL WP Base adhesiva de titanio AL, sin protección antirrotacional para 93720, incl. cofia de plástico y tornillo		Ponte Ponte Puente	Ø 6.8 mm	H 5.0 mm

CAD/CAM | CAD/CAM | CAD/CAM

77200	 TL WP Pilar para digitalização intraoral AL parafuso incluído TL WP Corpo di scansione per scansione intraorale AL incl. vite TL WP Cuerpo de referencia para AL intraoral incl. tornillo				
77201	 TL WP Pilar para digitalização intraoral IL parafuso incluído TL WP Corpo di scansione per scansione intraorale IL incl. vite TL WP Cuerpo de referencia para IL intraoral incl. tornillo				
77202	 TL WP Corpo de digitalização para scanner AL, sem parafuso 77601 TL WP Corpo di scansione per scanner da laboratorio AL senza vite 77601 TL WP Cuerpo de referencia para escáner AL, sin tornillo 77601				
77203	 TL WP Corpo de digitalização para scanner IL, sem parafuso 77602 TL WP Corpo di scansione per scanner da laboratorio IL senza vite 77602 TL WP Cuerpo de referencia para escáner IL, sin tornillo 77602				
77209	 TL WP Bloco de titânio pré-fresado IL incl. parafuso TL WP Blocco in titanio prefresato IL incl. vite TL WP Bloque de titanio prefresado IL incl. tornillo				
77601	 TL RP/WP Parafuso para corpo de digitalização para scanner AL TL RP/WP Vite corpo di scansione per scanner AL TL RP/WP Tornillo para cuerpo de referencia para escáner AL				L 4.5 mm
77602	 TL RP/WP Parafuso para corpo de digitalização para scanner IL TL RP/WP Vite corpo di scansione per scanner IL TL RP/WP Tornillo para cuerpo de referencia para escáner IL				L 6.7 mm

OKTAGON®

BONE LEVEL NC

PROTÉTICA





PROTESI

PRÓTESIS



▶ BONE LEVEL NC · PROTÉTICA | PROTESI | PRÓTESIS

IMPRESSÃO | IMPRONTA | PRISE D'EMPREINTE

22015		BL NC Espigão de impressão com parafuso de posicionamento integrado para procedimento de impressão com moldeira aberta Ø 4.0 mm	
		BL NC Transfer da impronta con vite di posizionamento integrata	per presa d'impronta aperta
22075		BL NC Poste de impresión con tornillo de posicionamiento	para la toma de impresión abierta Ø 5.5 mm
22074		BL NC/RC Parafuso de posicionamento para espigão de impressão	L 30 mm
		BL NC/RC Vite di posizionamento per transfer da impronta	
		BL NC/RC Tornillo de posicionamiento para poste de impresión	
22056		BL NC Espigão de impressão com parafuso de posicionamento integrado para procedimento de impressão com moldeira fechada	
		BL NC Transfer da impronta con vite di posizionamento integrata	per presa d'impronta chiusa
		BL NC Poste de impresión con tornillo de posicionamiento	para la toma de impresión cerrada
22016		BL NC Análogo de implante	
		BL NC Analogo d'impianto	
		BL NC Análogo de implante	

MEISINGER'S 11th ANNUAL

HACIS

HIGH ALTITUDE COMPREHENSIVE IMPLANT SYMPOSIUM



The safety and health of our guests and staff are of the utmost importance.











January 19th - 23rd 2022
Vail Marriott Mountain Resort
Vail, Colorado

For more information
visit www.meisingerusa.com
or call +1 303 268-5400








Meisinger

BONE LEVEL NC · PROTÉTICA | PROTESI | PRÓTESIS

CIMENTÁVEL | CEMENTABILI | CEMENTABLE

22023		BL NC Pilar, parafuso base incl. 22030 BL NC Abutment, incl. vite di base 22030	cimentável cementabili	paralelo paralelo	$\neq 0^\circ$	\varnothing 3.5 mm	GH 2.0 mm	H 6.0 mm
22024		BL NC Pilar, tornillo de base 22030 incl.	cementable	paralelo			GH 3.5 mm	
22027		BL NC Pilar, parafuso base incl. 22043	cimentável	cónico	$\neq 0^\circ$	\varnothing 3.5 mm	GH 1.0 mm	H 5.5 mm
22028		BL NC Abutment, incl. vite di base 22043	cementabili	conico			GH 2.0 mm	
22029		BL NC Pilar, tornillo de base 22043 incl.	cementable	cónico			GH 3.0 mm	
22025		BL NC Pilar, parafuso base incl. 22030 BL NC Abutment, incl. vite di base 22030	cimentável cementabili	cónico conico	$\neq 18^\circ$	\varnothing 3.5 mm	GH 1.5 mm	H 6.0 mm
22026		BL NC Pilar, tornillo de base 22030 incl.	cementable	cónico			GH 3.0 mm	
22250		BL NC Pilar ROX-CERA incl. parafuso base 22043 BL NC Abutment ROX-CERA, incl. vite di base 22043	cimentável cementabili	cónico conico	$\neq 0^\circ$	\varnothing 3.5 mm	GH 1.0 mm	H 5.5 mm
		BL NC Pilar ROX-CERA incl. tornillo de base 22043	cementable	cónico				
22251		BL NC Pilar ROX-CERA incl. parafuso base 22030 BL NC Abutment ROX-CERA, incl. vite di base 22030	cimentável cementabili	cónico conico	$\neq 18^\circ$	\varnothing 3.5 mm	GH 1.5 mm	H 6.0 mm
		BL NC Pilar ROX-CERA incl. tornillo de base 22030	cementable	cónico				
22030		BL NC Parafuso base BL NC Vite di base BL NC Tornillo de base						L 7.9 mm
22034		BL NC Tampa de plástico calcinável para 22027, 22028 e 22029 BL NC Cappetta in resina calcinabile per 22027, 22028 e 22029 BL NC Cofia de plástico calcinable para 22027, 22028 y 22029		Coroa Corona Corona		\varnothing 3.5 mm		
22035		BL NC Tampa de plástico calcinável para 22027, 22028 e 22029 BL NC Cappetta in resina calcinabile per 22027, 22028 e 22029 BL NC Cofia de plástico calcinable para 22027, 22028 y 22029		Ponte/Barra Ponte/Barra Puente/Barra		\varnothing 3.5 mm		
22043		BL NC Parafuso base BL NC Vite di base BL NC Tornillo de base						L 7.9 mm
22252		BL NC Pilar provisório com bloqueio contra rotação, incl. parafuso BL NC Abutment provvisorio con ingaggio, incl. vite BL NC Pilar provisional con protección antirrotacional, incl. tornillo						H 14.7 mm

BASES ADESIVAS DE TITÂNIO | BASI ADESIVE IN TITANIO | BASES ADHESIVAS DE TITANIO






22058		BL NC Base adesiva de titânio com bloqueio contra rotação incl. 31167 e 22120 BL NC Base adesiva in titanio con ingaggio, incl. 31167 e 22120 BL NC Bases adhesivas de titanio con protección antirrotacional, incl. 31167 y 22120		paralelo paralelo paralelo	$\neq 0^\circ$	\varnothing 3.5 mm	H 5.5 mm	
22059		BL NC Base adesiva de titânio com bloqueio contra rotação incl. 31167 e 22120 BL NC Base adesiva in titanio con ingaggio, incl. 31167 e 22120 BL NC Bases adhesivas de titanio con protección antirrotacional, incl. 31167 y 22120		paralelo paralelo paralelo	$\neq 15^\circ$	\varnothing 3.5 mm	H 5.5 mm	
31167		TL/BL Manga de plástico calcinável TL/BL Cappetta in resina calcinabile TL/BL Casquillo de plástico calcinable						H 11.0 mm
22120		BL NC/RC Parafuso base BL NC/RC Vite di base BL NC/RC Tornillo de base	também indicado para CAD/CAM idonea anche per CAD/CAM también indicado para CAD/CAM					L 7.9 mm
77304		BL NC Base adesiva de titânio IL, com bloqueio contra rotação, incl. tampa de plástico e parafuso BL NC Base adesiva in titanio IL, con ingaggio, incl. cappetta in resina e vite BL NC Base adesiva de titanio IL, con protección antirrotacional, incl. cofia de plástico y tornillo		Coroa Corona Corona				H 4.2 mm
77306		BL NC Base adesiva de titânio IL, sem bloqueio contra rotação, incl. tampa de plástico e parafuso BL NC Base adesiva in titanio IL, senza ingaggio, incl. cappetta in resina e vite BL NC Base adesiva de titanio IL, sin protección antirrotacional, incl. cofia de plástico y tornillo		Ponte Ponte Puente				H 4.2 mm
77308		BL NC Base adesiva de titânio C IL, com bloqueio contra rotação, incl. parafuso BL NC Base adesiva in titanio C IL, con protezione e vite BL NC Base adesiva de titanio C IL, con protección antirrotacional, incl. tornillo		para Dentsply Sirona CEREC per Dentsply Sirona CEREC para Dentsply Sirona CEREC				H 4.7 mm

▶ BONE LEVEL NC · PROTÉTICA | PROTESI | PRÓTESIS

MULTI-UNITS | MULTI-UNIT | MULTI-UNITS

77310		BL NC Pilar Multi-Unit BL NC Abutment Multi-Unit BL NC Pilar Multi-Unit	∠ 0°	GH 1.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm
77311		BL NC Pilar Multi-Unit BL NC Abutment Multi-Unit BL NC Pilar Multi-Unit	∠ 0°	GH 2.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm
77312		BL NC Pilar Multi-Unit BL NC Abutment Multi-Unit BL NC Pilar Multi-Unit	∠ 0°	GH 3.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm
77314		BL NC Pilar Multi-Unit, incl. parafuso BL NC Abutment Multi-Unit, incl. vite BL NC Pilar Multi-Unit, incl. tornillo	∠ 17°	GH 2.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm
77315		BL NC Pilar Multi-Unit, incl. parafuso BL NC Abutment Multi-Unit, incl. vite BL NC Pilar Multi-Unit, incl. tornillo	∠ 17°	GH 3.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm
77316		BL NC Pilar Multi-Unit, incl. parafuso BL NC Abutment Multi-Unit, incl. vite BL NC Pilar Multi-Unit, incl. tornillo	∠ 30°	GH 3.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm
77317		BL NC Pilar Multi-Unit, incl. parafuso BL NC Abutment Multi-Unit, incl. vite BL NC Pilar Multi-Unit, incl. tornillo	∠ 30°	GH 4.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm

CAD/CAM | CAD/CAM | CAD/CAM

77301		BL NC Pilar para digitalização intraoral IL parafuso incluído BL NC Corpo di scansione per scansione intraorale IL incl. vite BL NC Cuerpo de referencia para IL intraoral incl. tornillo				
77303		BL NC Corpo de digitalização para scanner IL, sem parafuso 77604 BL NC Corpo di scansione per scanner da laboratorio IL senza vite 77604 BL NC Cuerpo de referencia para escáner IL, sin tornillo 77604				
77604		BL NC/RC Parafuso para corpo de digitalização para scanner IL BL NC/RC Vite corpo di scansione per scanner IL BL NC/RC Tornillo para cuerpo de referencia para escáner IL				L 7.85 mm
77309		BL NC Bloco de titânio pré-fresado IL incl. parafuso BL NC Blocco in titanio prefresato IL, incl. vite BL NC Bloque de titanio prefresado IL incl. tornillo				
22032		BL NC Parafuso base para CAD/CAM BL NC Vite di base per CAD/CAM BL NC Tornillo de base para CAD/CAM				L 7.9 mm












Os dados de fresagem para a restauração CAD/CAM podem ser pedidos por e-mail para cadcam@meisingerimplants.com

I dati di fresatura per il restauro CAD/CAM possono essere richiesti via e-mail all'indirizzo cadcam@meisingerimplants.com






Los datos del fresado para la restauración CAD/CAM se pueden solicitar por correo electrónico en la dirección cadcam@meisingerimplants.com

BONE LEVEL NC · PROTÉTICA | PROTESI | PRÓTESIS

ACESSÓRIOS | ACCESSORI | ACCÉSSOIRES

















77500		BL NC/RC Espigão de impressão para Multi-Unit incl. 2 parafusos BL NC/RC Transfer da impronta per Multi-Unit incl. 2 viti BL NC/RC Poste de impresión para Multi-Unit incl. 2 tornillos		H 12 mm
77501		BL NC/RC Corpo de digitalização para aplicação intraoral em Multi-Unit incl. parafuso BL NC/RC Corpo di scansione per scansione intraorale su Multi-Unit, incl. vite BL NC/RC Cuerpo de referencia para escaneado intraoral sobre Multi-Unit incl. tornillo		
77502		BL NC/RC Análogo de implante para Multi-Unit BL NC/RC Analogo per Multi-Unit BL NC/RC Análogo de implante para Multi-Unit		
77503		BL NC/RC Corpo de digitalização para scanner em Multi-Unit, sem parafuso 77603 BL NC/RC Corpo di scansione per scanner da laboratorio su Multi-Unit, senza vite 77603 BL NC/RC Cuerpo de referencia para escáner sobre Multi-Unit, sin tornillo 77603		
77504		BL NC/RC Pilar provisório para Multi-Unit, incl. 77603 BL NC/RC Abutment provvisorio per Multi-Unit, incl. 77603 BL NC/RC Pilar provisional para Multi-Unit, incl. 77603		H 10 mm
77505		BL NC/RC Tampa de plástico para Multi-Unit, incl. 77603 BL NC/RC Cappetta in resina calcinabile per Multi-Unit, incl. 77603 BL NC/RC Cofia de plástico calcinable para Multi-Unit, 77603 incl.		H 10 mm
77506		BL NC/RC Pilar de cicatrização para Multi-Unit BL NC/RC Vite di guarigione per Multi-Unit BL NC/RC Pilar de cicatrización para Multi-Unit	Ø 4.8 mm	H 4.2 mm
77507		BL NC/RC Base adesiva de titânio em Multi-Unit, incl. tampa de plástico e parafuso BL NC/RC Base adesiva in titanio su Multi-Unit, incl. cappetta in resina e vite BL NC/RC Base adhesiva sobre Multi-Unit, incl. cofia de plástico y tornillo	Ø 5.0 mm	H 5.7 mm
77603		BL NC/RC Parafuso oclusal para pilares Multi-Unit e 77503 BL NC/RC Vite occlusale per abutment Multi-Unit e 77503 BL NC/RC Tornillo oclusal para Multi-Unit y 77503		L 3.45 mm
77703		Ponta de chave de encaixar Multi-Unit Strumento di inserimento Multi-Unit Instrumento auxiliar de inserción Multi-Unit		L 24 mm
77900		Chave de parafusos uma peça CAD/CAM Cacciavite monopezzo CAD/CAM Destornillador una pieza CAD/CAM		L 30 mm

HÍBRIDO | IBRIDA | HIBRIDO

22036		BL NC ALLIGATOR Pilar	∠ 0°	GH 2.0 mm
22037		BL NC ALLIGATOR Abutment		GH 3.0 mm
22038		BL NC ALLIGATOR Pilar		GH 4.0 mm
22039				GH 5.0 mm
22041		BL NC ALLIGATOR Pilar, parafuso base incl. 22131	∠ 15°	GH 3.0 mm
22042		BL NC ALLIGATOR Abutment, incl. vite di base 22131		GH 4.0 mm
22131		BL NC/RC ALLIGATOR Parafuso base		L 8.0 mm
		BL NC/RC ALLIGATOR Vite di base		
		BL NC/RC ALLIGATOR Tornillo de base		
75836		ALLIGATOR Ponta de chave de encaixar para roquete ALLIGATOR Strumento di inserimento per cricchetto ALLIGATOR Instrumento auxiliar de inserción para carraca		L 15.0 mm
63978		OKTAGON® Chave de parafusos uma peça		L 18.0 mm
64551		OKTAGON® Cacciavite monopezzo		L 24.0 mm
64553		OKTAGON® Destornillador una pieza		L 30.0 mm

BONE LEVEL NC · PROTÉTICA | PROTESI | PRÓTESIS

ALLIGATOR HÍBRIDO | ALLIGATOR IBRIDA | ALLIGATOR HIBRIDO

16040		Tampa de transferência Transfer da impronta Cofia de transferencia				4 un. 4 pz. 4 uu.
16041		Análogo do modelo Analogo da laboratorio Implante de laboratorio				4 un. 4 pz. 4 uu.
16010		Pacote de processamento de matrizes para angulação (divergência 0° a 20°) incl. inserto de montagem preto, colar de montagem e insertos de retenção em amarelo, rosa-choque, transparente, lilás Confezione di trattamento con matrice per angolazione ridotta (divergenza da 0° a 20°) incl. inserto di montaggio nero, dischetto protettivo e inserti di ritenzione gialli, rosa, trasparente, viola Paquete de procesado de matrices para corrección de la angulación (divergencia entre 0° a 20°) incl. aditamento de montaje negro, collar de montaje y aditamentos retentivos amarillo, rosa, transparente, violeta				
16011		Inserto de retenção para angulação Inserto di ritenzione per angolazione ridotta Aditamento retentivo para angulación	amarelo gialla amarillo	Força de retenção Forza di ritenzione Fuerza de retención	0.7 kg	4 un. 4 pz. 4 uu.
16012		Inserto de retenção para angulação Inserto di ritenzione per angolazione ridotta Aditamento retentivo para angulación	rosa-choque rosa rosa	Força de retenção Forza di ritenzione Fuerza de retención	0.9 kg	4 un. 4 pz. 4 uu.
16013		Inserto de retenção para angulação Inserto di ritenzione per angolazione ridotta Aditamento retentivo para angulación	transparente trasparente transparente	Força de retenção Forza di ritenzione Fuerza de retención	1.5 kg	4 un. 4 pz. 4 uu.
16014		Inserto de retenção para angulação Inserto di ritenzione per angolazione ridotta Aditamento retentivo para angulación	lilás viola violeta	Força de retenção Forza di ritenzione Fuerza de retención	1.8 kg	4 un. 4 pz. 4 uu.
16021		Pacote de processamento de matrizes para angulação alargada (divergência 0° a 40°) incl. inserto de montagem preto, colar de montagem e insertos de retenção em amarelo, rosa-choque, transparente, lilás Confezione di trattamento con matrice per angolazione estesa (divergenza da 0° a 40°) incl. inserto di montaggio nero, dischetto protettivo e inserti di ritenzione gialli, rosa, trasparente, viola Paquete de procesado de matrices para corrección de la angulación ampliada (divergencia entre 0° a 40°) incl. aditamento de montaje negro, collar de montaje y aditamentos retentivos amarillo, rosa, transparente, violeta				
16022		Inserto de retenção para angulação alargada Inserto di ritenzione per angolazione estesa Aditamento retentivo para angulación ampliada	amarelo gialla amarillo	Força de retenção Forza di ritenzione Fuerza de retención	0.6 kg	4 un. 4 pz. 4 uu.
16023		Inserto de retenção para angulação alargada Inserto di ritenzione per angolazione estesa Aditamento retentivo para angulación ampliada	rosa-choque rosa rosa	Força de retenção Forza di ritenzione Fuerza de retención	0.8 kg	4 un. 4 pz. 4 uu.
16024		Inserto de retenção para angulação alargada Inserto di ritenzione per angolazione estesa Aditamento retentivo para angulación ampliada	transparente trasparente transparente	Força de retenção Forza di ritenzione Fuerza de retención	1.0 kg	4 un. 4 pz. 4 uu.
16025		Inserto de retenção para angulação alargada Inserto di ritenzione per angolazione estesa Aditamento retentivo para angulación ampliada	lilás viola violeta	Força de retenção Forza di ritenzione Fuerza de retención	1.5 kg	4 un. 4 pz. 4 uu.
16030		Invólucro de matriz de titânio Matrice in titanio Carcasa de matriz				2 un. 2 pz. 2 uu.
16035		Colar de montagem Dischetto protettivo Collar de montaje				10 un. 10 pz. 10 uu.
16042		Inserto de montagem Inserto di montaggio Collar de montaje	preto nero negro			4 un. 4 pz. 4 uu.
16050		Instrumento de montagem e desmontagem para insertos de retenção Inseritore/estrattore di inserti di ritenzione Instrumento para la colocación y la retirada de los aditamentos retentivos				

OKTAGON®

BONE LEVEL RC

PROTÉTICA







PROTESI

PRÓTESIS



BONE LEVEL RC · PROTÉTICA | PROTESI | PRÓTESIS

IMPRESSÃO | IMPRONTA | PRISE D'EMPREINTE

22096		BL RC Espigão de impressão com parafuso de posicionamento integrado para procedimento de impressão com moldeira aberta	Ø 4.5 mm
22088		BL RC Transfer da impronta con vite di posizionamento integrata	per presa d'impronta aperta Ø 5.0 mm
22089		BL RC Poste de impresión con tornillo de posicionamiento	para la toma de impresión abierta Ø 6.5 mm
22074		BL NC/RC Parafuso de posicionamento para espigão de impressão	L 30 mm
		BL NC/RC Vite di posizionamento per transfer da impronta	
		BL NC/RC Tornillo de posicionamiento para poste de impresión	
22087		BL RC Espigão de impressão com parafuso de posicionamento integrado para procedimento de impressão com moldeira fechada	
		BL RC Transfer da impronta con vite di posizionamento integrata	per presa d'impronta chiusa
		BL RC Poste de impresión con tornillo de posicionamiento	para la toma de impresión cerrada
22097		BL RC Análogo de implante	
		BL RC Analogo d'impianto	
		BL RC Análogo de implante	

MEISINGER'S 12th ANNUAL

HACIS

HIGH ALTITUDE COMPREHENSIVE IMPLANT SYMPOSIUM



The safety and health of our guests and staff are of the utmost importance.

January 24th - 28rd 2023
Robinson Club Zürs
Zürs/Lech, Austria













For more information
visit www.meisingerusa.com
or call +1 303 268-5400








BONE LEVEL RC · PROTÉTICA | PROTESI | PRÓTESIS

CIMENTÁVEL | CEMENTABILI | CEMENTABLE




22106		BL RC Pilar, parafuso base incl. 22120	cimentável	cónico	≠ 0°	Ø 5.0 mm	GH 1.0 mm	H 6.0 mm
22107		BL RC Abutment, incl. vite di base 22120	cementabili	conico			GH 2.0 mm	
22108		BL RC Pilar, tornillo de base 22120 incl.	cementable	cónico			GH 3.0 mm	
22103		BL RC Pilar, parafuso base incl. 22122	cimentável	cónico	≠ 18°	Ø 5.0 mm	GH 1.5 mm	H 8.0 mm
		BL RC Abutment, incl. vite di base 22122	cementabili	conico				
22105		BL RC Pilar, tornillo de base 22122 incl.	cementable	cónico			GH 3.0 mm	
22160		BL RC Pilar ROX-CERA incl. parafuso base 22120	cimentável	cónico	≠ 0°	Ø 5.0 mm	GH 1.0 mm	H 6.0 mm
		BL RC Abutment ROX-CERA , incl. vite di base 22120	cementabili	conico				
		BL RC Pilar ROX-CERA incl. tornillo de base 22120	cementable	cónico				
22161		BL RC Pilar ROX-CERA incl. parafuso base 22122	cimentável	cónico	≠ 18°	Ø 5.0 mm	GH 1.5 mm	H 8.0 mm
		BL RC Abutment ROX-CERA , incl. vite di base 22122	cementabili	conico				
		BL RC Pilar ROX-CERA incl. tornillo de base 22122	cementable	cónico				
22109		BL RC Pilar, parafuso base incl. 22120	cimentável	cónico	≠ 0°	Ø 6.5 mm	GH 1.0 mm	H 6.0 mm
22110		BL RC Abutment, incl. vite di base 22120	cementabili	conico			GH 2.0 mm	
22115		BL RC Pilar, tornillo de base 22120 incl.	cementable	cónico			GH 3.0 mm	
22121		BL RC Pilar provisório, individualizável, incl. parafuso base 22122		paralelo	≠ 0°	Ø 7.0 mm		
		BL RC Abutment provvisorio, personalizzabile, incl. vite di base 22122		parallelo				
		BL RC Pilar provisional, individualizable, incl. tornillo de base 22122		paralelo				
22122		BL RC Parafuso base também indicado para CAD/CAM						L 7.9 mm
		BL RC Vite di base idonea anche per CAD/CAM						
		BL RC Tornillo de base también indicado para CAD/CAM						
22199		BL RC Pilar provisório com bloqueio contra rotação, incl. parafuso						H 16.4 mm
		BL RC Abutment provvisorio con ingaggio, incl. vite						
		BL RC Pilar provisional con protección antirrotacional, incl. tornillo						
22117		BL RC Tampa de plástico calcinável para 22106, 22107 e 22108		Coroa		Ø 5.0 mm		
		BL RC Cappetta in resina calcinabile per 22106, 22107 e 22108		Corona				
		BL RC Cofia de plástico calcinable para 22106, 22107 y 22108		Corona				
22116		BL RC Tampa de plástico calcinável para 22106, 22107 e 22108		Ponte/Barra		Ø 5.0 mm		
		BL RC Cappetta in resina calcinabile per 22106, 22107 e 22108		Ponte/Barra				
		BL RC Cofia de plástico calcinable para 22106, 22107 y 22108		Puente/Barra				
22119		BL RC Tampa de plástico calcinável para 22109, 22110 e 22115		Coroa		Ø 6.5 mm		
		BL RC Cappetta in resina calcinabile per 22109, 22110 e 22115		Corona				
		BL RC Cofia de plástico calcinable para 22109, 22110 y 22115		Corona				
22118		BL RC Tampa de plástico calcinável para 22109, 22110 und 22115		Ponte/Barra		Ø 6.5 mm		
		BL RC Cappetta in resina calcinabile per 22109, 22110 e 22115		Ponte/Barra				
		BL RC Cofia de plástico calcinable para 22109, 22110 y 22115		Puente/Barra				

BASES ADESIVAS DE TITÂNIO | BASI ADESIVE IN TITANIO | BASES ADHESIVAS DE TITANIO

22150		BL RC Base adesiva de titânio com bloqueio contra rotação incl. 31167 e 22120		paralelo	≠ 15°	Ø 3.5 mm	H 5.5 mm	
		BL RC Base adesiva in titanio con ingaggio, incl. 31167 e 22120		parallelo				
		BL RC Bases adhesivas de titanio con protección antirrotacional, incl. 31167 y 22120		paralelo				
31167		TL/BL Manga de plástico calcinável						H 11.0 mm
		TL/BL Cappetta in resina calcinabile						
		TL/BL Casquillo de plástico calcinable						
22120		BL NC/RC Parafuso base também indicado para CAD/CAM						L 7.9 mm
		BL NC/RC Vite di base idonea anche per CAD/CAM						
		BL NC/RC Tornillo de base también indicado para CAD/CAM						

▶ BONE LEVEL RC · PROTÉTICA | PROTESI | PRÓTESIS





BASES ADESIVAS DE TITÂNIO | BASI ADESIVE IN TITANIO | BASES ADHESIVAS DE TITANIO

77404		BL RC Base adesiva de titânio IL, com bloqueio contra rotação, incl. tampa de plástico e parafuso	Coroa	H 4.2 mm
		BL RC Base adesiva in titanio IL, con ingaggio, incl. cappetta in resina e vite	Corona	
		BL RC Base adhesiva de titanio IL, con protección antirrotacional, incl. cofia de plástico y tornillo	Corona	
77406		BL RC Base adesiva de titânio IL, sem bloqueio contra rotação, incl. tampa de plástico e parafuso	Ponte	H 4.2 mm
		BL RC Base adesiva in titanio IL, senza ingaggio, incl. cappetta in resina e vite	Ponte	
		BL RC Base adhesiva de titanio IL, sin protección antirrotacional, incl. cofia de plástico y tornillo	Puente	
77408		BL RC Base adesiva de titânio C IL, com bloqueio contra rotação, incl. parafuso	para Dentsply Sirona CEREC GH 1.0 mm	H 4.7 mm
		BL RC Base adesiva in titanio C IL, con ingaggio, incl. vite	per Dentsply Sirona CEREC	
		BL RC Base adhesiva de titanio C IL, con protección antirrotacional, incl. tornillo	para Dentsply Sirona CEREC	

MULTI-UNITS | MULTI-UNIT | MULTI-UNITS












77410		BL RC Pilar Multi-Unit	$\neq 0^\circ$	\varnothing 4.8 mm	GH 1.5 mm	H 2.2 mm
		BL RC Abutment Multi-Unit				
		BL RC Pilar Multi-Unit				
77411		BL RC Pilar Multi-Unit	$\neq 0^\circ$	\varnothing 4.8 mm	GH 2.5 mm	H 2.2 mm
		BL RC Abutment Multi-Unit				
		BL RC Pilar Multi-Unit				
77412		BL RC Pilar Multi-Unit	$\neq 0^\circ$	\varnothing 4.8 mm	GH 3.5 mm	H 2.2 mm
		BL RC Abutment Multi-Unit				
		BL RC Pilar Multi-Unit				
77413		BL RC Pilar Multi-Unit	$\neq 0^\circ$	\varnothing 4.8 mm	GH 4.5 mm	H 2.2 mm
		BL RC Abutment Multi-Unit				
		BL RC Pilar Multi-Unit				
77414		BL RC Pilar Multi-Unit, incl. parafuso	$\neq 17^\circ$	\varnothing 4.8 mm	GH 2.5 mm	H 2.2 mm
		BL RC Abutment Multi-Unit, incl. vite				
		BL RC Pilar Multi-Unit, incl. tornillo				
77415		BL RC Pilar Multi-Unit, incl. parafuso	$\neq 17^\circ$	\varnothing 4.8 mm	GH 3.5 mm	H 2.2 mm
		BL RC Abutment Multi-Unit, incl. vite				
		BL RC Pilar Multi-Unit, incl. tornillo				
77416		BL RC Pilar Multi-Unit, incl. parafuso	$\neq 30^\circ$	\varnothing 4.8 mm	GH 3.5 mm	H 2.2 mm
		BL RC Abutment Multi-Unit, incl. vite				
		BL RC Pilar Multi-Unit, incl. tornillo				
77417		BL RC Pilar Multi-Unit, incl. parafuso	$\neq 30^\circ$	\varnothing 4.8 mm	GH 4.5 mm	H 2.2 mm
		BL RC Abutment Multi-Unit, incl. vite				
		BL RC Pilar Multi-Unit, incl. tornillo				

CAD/CAM | CAD/CAM | CAD/CAM

77401		BL RC Pilar para digitalização intraoral IL parafuso incluído				
		BL RC Corpo di scansione per scansione intraorale IL incl. vite				
		BL RC Cuerpo de referencia para IL intraoral incl. tornillo				
77403		BL RC Corpo de digitalização para scanner IL, sem parafuso 77604				
		BL RC Corpo di scansione per scanner da laboratorio IL senza vite 77604				
		BL RC Cuerpo de referencia para escáner IL, sin tornillo 77604				
77604		BL NC/RC Parafuso para corpo de digitalização para scanner IL				L 7.85 mm
		BL NC/RC Vite corpo di scansione per scanner IL				
		BL NC/RC Tornillo para cuerpo de referencia para escáner IL				
77409		BL RC Bloco de titânio pré-fresado IL incl. parafuso				
		BL RC Blocco in titanio prefresato IL, incl. vite				
		BL RC Bloque de titanio prefresado IL incl. tornillo				

BONE LEVEL NC/RC · PROTÉTICA | PROTESI | PRÓTESIS

ACESSÓRIOS | ACCESSORI | ACCESORIOS

















77500		BL NC/RC Espigão de impressão para Multi-Unit incl. 2 parafusos BL NC/RC Transfer da impronta per Multi-Unit incl. 2 viti BL NC/RC Poste de impresión para Multi-Unit incl. 2 tornillos		H 12 mm
77501		BL NC/RC Corpo de digitalização para aplicação intraoral em Multi-Unit incl. parafuso BL NC/RC Corpo di scansione per scansione intraorale su Multi-Unit, incl. vite BL NC/RC Cuerpo de referencia para escaneado intraoral sobre Multi-Unit incl. tornillo		
77502		BL NC/RC Análogo de implante para Multi-Unit BL NC/RC Análogo per Multi-Unit BL NC/RC Análogo de implante para Multi-Unit		
77503		BL NC/RC Corpo de digitalização para scanner em Multi-Unit, sem parafuso 77603 BL NC/RC Corpo di scansione per scanner da laboratorio su Multi-Unit, senza vite 77603 BL NC/RC Cuerpo de referencia para escáner sobre Multi-Unit, sin tornillo 77603		
77504		BL NC/RC Pilar provisório para Multi-Unit, incl. 77603 BL NC/RC Abutment provvisorio per Multi-Unit, incl. 77603 BL NC/RC Pilar provisional para Multi-Unit, incl. 77603		H 10 mm
77505		BL NC/RC Tampa de plástico calcinável para Multi-Unit, incl. 77603 BL NC/RC Cappetta in resina calcinabile per Multi-Unit, incl. 77603 BL NC/RC Cofia de plástico calcinable para Multi-Unit, 77603 incl.		H 10 mm
77506		BL NC/RC Pilar de cicatrização para Multi-Unit BL NC/RC Vite di guarigione per Multi-Unit BL NC/RC Pilar de cicatrización para Multi-Unit	Ø 4.8 mm	H 4.2 mm
77507		BL NC/RC Base adesiva de titânio em Multi-Unit, incl. tampa de plástico e parafuso BL NC/RC Base adesiva in titanio su Multi-Unit, incl. cappetta in resina e vite BL NC/RC Base adhesiva sobre Multi-Unit, incl. cofia de plástico y tornillo	Ø 5.0 mm	H 5.7 mm
77603		BL NC/RC Parafuso oclusal para pilares Multi-Unit e 77503 BL NC/RC Vite occlusale per abutment Multi-Unit e 77503 BL NC/RC Tornillo oclusal para Multi-Unit y 77503		L 3.45 mm
77703		Ponta de chave de encaixar Multi-Unit Strumento di inserimento Multi-Unit Instrumento auxiliar de inserción Multi-Unit		L 24 mm
77900		CAD/CAM Chave de parafusos uma peça CAD/CAM Cacciavite monopezzo Destornillador una pieza CAD/CAM		L 30 mm

HÍBRIDO | IBRIDA | HIBRIDO

22124		BL RC ALLIGATOR Pilar	≠ 0°	GH 1.0 mm
22125		BL RC ALLIGATOR Abutment		GH 2.0 mm
22126		BL RC ALLIGATOR Pilar		GH 3.0 mm
22127				GH 4.0 mm
22128				GH 5.0 mm
22129		BL RC ALLIGATOR Pilar, parafuso base incl. 22131	≠ 15°	GH 3.0 mm
22130		BL RC ALLIGATOR Abutment, incl. vite di base 22131		
22131		BL RC ALLIGATOR Pilar, incl. tornillo de base 22131		GH 4.0 mm
22131		BL NC/RC ALLIGATOR Parafuso base		L 8.0 mm
		BL NC/RC ALLIGATOR Vite di base		
		BL NC/RC ALLIGATOR Tornillo de base		
75836		ALLIGATOR Ponta de chave de encaixar para roquete		L 15.0 mm
		ALLIGATOR Strumento di inserimento per cricchetto		
		ALLIGATOR Instrumento auxiliar de inserción para carraca		
63978		OKTAGON® Chave de parafusos uma peça		L 18.0 mm
64551		OKTAGON® Cacciavite monopezzo		L 24.0 mm
64553		OKTAGON® Destornillador una pieza		L 30.0 mm

BONE LEVEL RC · PROTÉTICA | PROTESI | PRÓTESIS

ALLIGATOR HÍBRIDO | ALLIGATOR IBRIDA | ALLIGATOR HIBRIDO

16040		Tampa de transferência Transfer da impronta Cofia de transferencia				4 un. 4 pz. 4 uu.
16041		Análogo do modelo Analogo da laboratorio Implante de laboratorio				4 un. 4 pz. 4 uu.
16010		Pacote de processamento de matrizes para angulação (divergência 0° a 20°) incl. inserto de montagem preto, colar de montagem e insertos de retenção em amarelo, rosa-choque, transparente, lilás Confezione di trattamento con matrice per angolazione ridotta (divergenza da 0° a 20°) incl. inserto di montaggio nero, dischetto protettivo e inserti di ritenzione gialli, rosa, trasparente, viola Paquete de procesado de matrices para corrección de la angulación (divergencia entre 0° a 20°) incl. aditamento de montaje negro, collar de montaje y aditamentos retentivos amarillo, rosa, transparente, violeta				
16011		Inserto de retenção para angulação Inserto di ritenzione per angolazione ridotta Aditamento retentivo para angulación	amarelo gialla amarillo	Força de retenção Forza di ritenzione Fuerza de retención	0.7 kg	4 un. 4 pz. 4 uu.
16012		Inserto de retenção para angulação Inserto di ritenzione per angolazione ridotta Aditamento retentivo para angulación	rosa-choque rosa rosa	Força de retenção Forza di ritenzione Fuerza de retención	0.9 kg	4 un. 4 pz. 4 uu.
16013		Inserto de retenção para angulação Inserto di ritenzione per angolazione ridotta Aditamento retentivo para angulación	transparente trasparente transparente	Força de retenção Forza di ritenzione Fuerza de retención	1.5 kg	4 un. 4 pz. 4 uu.
16014		Inserto de retenção para angulação Inserto di ritenzione per angolazione ridotta Aditamento retentivo para angulación	lilás viola violeta	Força de retenção Forza di ritenzione Fuerza de retención	1.8 kg	4 un. 4 pz. 4 uu.
16021		Pacote de processamento de matrizes para angulação alargada (divergência 0° a 40°) incl. inserto de montagem preto, colar de montagem e insertos de retenção em amarelo, rosa-choque, transparente, lilás Confezione di trattamento con matrice per angolazione estesa (divergenza da 0° a 40°) incl. inserto di montaggio nero, dischetto protettivo e inserti di ritenzione gialli, rosa, trasparente, viola Paquete de procesado de matrices para corrección de la angulación ampliada (divergencia entre 0° a 40°) incl. aditamento de montaje negro, collar de montaje y aditamentos retentivos amarillo, rosa, transparente, violeta				
16022		Inserto de retenção para angulação alargada Inserto di ritenzione per angolazione estesa Aditamento retentivo para angulación ampliada	amarelo gialla amarillo	Força de retenção Forza di ritenzione Fuerza de retención	0.6 kg	4 un. 4 pz. 4 uu.
16023		Inserto de retenção para angulação alargada Inserto di ritenzione per angolazione estesa Aditamento retentivo para angulación ampliada	rosa-choque rosa rosa	Força de retenção Forza di ritenzione Fuerza de retención	0.8 kg	4 un. 4 pz. 4 uu.
16024		Inserto de retenção para angulação alargada Inserto di ritenzione per angolazione estesa Aditamento retentivo para angulación ampliada	transparente trasparente transparente	Força de retenção Forza di ritenzione Fuerza de retención	1.0 kg	4 un. 4 pz. 4 uu.
16025		Inserto de retenção para angulação alargada Inserto di ritenzione per angolazione estesa Aditamento retentivo para angulación ampliada	lilás viola violeta	Força de retenção Forza di ritenzione Fuerza de retención	1.5 kg	4 un. 4 pz. 4 uu.
16030		Invólucro de matriz de titânio Matrice in titanio Carcasa de matriz				2 un. 2 pz. 2 uu.
16035		Colar de montagem Dischetto protettivo Collar de montaje				10 un. 10 pz. 10 uu.
16042		Inserto de montagem Inserto di montaggio Collar de montaje	preto nero negro			4 un. 4 pz. 4 uu.
16050		Instrumento de montagem e desmontagem para insertos de retenção Inseritore/estrattore di inserti di ritenzione Instrumento para la colocación y la retirada de los aditamentos retentivos				







INSTRUMENTOS
STRUMENTI
INSTRUMENTOS





OKTAGON® · FERRAMENTAS | AUSILIARI | HERRAMIENTAS

31050		TL/BL Extensão de broca TL/BL Prolunga per fresa TL/BL Prolongador de fresas			L 30.0 mm
31056		OKTAGON® Adaptador para cotovelo OKTAGON® Adattatore per contrangolo			L 19.0 mm
31057		OKTAGON® Adaptador para contraângulo			L 24.0 mm
64558		OKTAGON® Adaptador para roquete OKTAGON® Adattatore per cricchetto			L 11.0 mm
17372		OKTAGON® Adaptador para carraca			L 21.0 mm
63978		OKTAGON® Chave de parafusos uma peça			L 18.0 mm
64551		OKTAGON® Cacciavite monopezzo			L 24.0 mm
64553		OKTAGON® Destornillador una pieza			L 30.0 mm
31052		OKTAGON® Chave de parafusos para cotovelo OKTAGON® Cacciavite per contrangolo OKTAGON® Desatornillador para contraângulo			L 24.0 mm
89048		OKTAGON® Roquete dinamométrico OKTAGON® Cricchetto dinamometrico OKTAGON® Carraca dinamométrica			
64564		OKTAGON® BL NC Chave de extracção OKTAGON® BL NC Chiave di estrazione OKTAGON® BL NC Llave de extracción		NEW	
64565		OKTAGON® TL RP/WP/BL RC Chave de extracção OKTAGON® TL RP/WP/BL RC Chiave di estrazione OKTAGON® TL RP/WP/BL RC Llave de extracción		NEW	
64563		OKTAGON® Chave de retenção OKTAGON® Chiavetta di ritegno OKTAGON® Llave de retención			
87434		OKTAGON® Esfera de referência para raio X OKTAGON® Sfera di riferimento per radiografia OKTAGON® Bola de referencia radiográfica	Ø 5.0 mm	4 un. 4 pz. 4 uu.	
64548		TL RP/WP 48h Instrumento de explantação TL RP/WP 48h Strumento d'espianto			L 19.0 mm
64549		TL RP/WP 48h Instrumento de explantación			L 25.0 mm
64547		BL NC 48h Instrumento de explantação BL NC 48h Strumento d'espianto BL NC 48h Instrumento de explantación			L 28.0 mm
64550		BL RC 48h Instrumento de explantação BL RC 48h Strumento d'espianto BL RC 48h Instrumento de explantación			L 29.0 mm
64542		TL/BL Instrumento de remoção de parafusos TL/BL Strumento per estrazione viti TL/BL Instrumento para la extracción de tornillos			L 27.5 mm
64545		TL RP Manga-guia TL RP Guida a manicotto TL RP Casquillo guía			L 13.0 mm
64546		TL WP Manga-guia TL WP Guida a manicotto TL WP Casquillo guía			L 13.0 mm
64543		BL NC Manga-guia BL NC Guida a manicotto BL NC Casquillo guía			L 11.0 mm
64544		BL RC Manga-guia BL RC Guida a manicotto BL RC Casquillo guía			L 13.0 mm

OKTAGON® · ACESSÓRIOS | ACCESSORI | ACCESORIOS

38171		TL/BL DRILL-STOP-CONTROL SET	Conteúdo: 1 unidade de cada referência 38160-38168 e 38170		
		TL/BL DRILL-STOP-CONTROL SET	Contenuto: 1 pz. ciascuno degli articoli 38160-38168 e 38170		
		TL/BL DRILL-STOP-CONTROL SET	Contenido: 1 u. de las referencias 38160-38168 y 38170		
		<i>Não indicado para para implantes CONICAL e BLT; Ø 3.75 mm implantes apenas em combinação com o artigo 38159</i> <i>Non idoneo per impianti CONICAL e BLT; impianti Ø 3.75 mm solo in associazione all'articolo 38159</i> <i>No indicado para los implantes CONICAL y BLT; para implantes de Ø 3.75 mm sólo en combinación con el artículo 38159</i>			
38170		Broca piloto Fresa pilota Fresa piloto	Ø 1.8 mm 5 un. 5 pz. 5 uu.	L 34.0 mm	
38160		TL/BL Broca helicoidal	Ø 2.0 mm	L 34.0 mm	
38161		TL/BL Frese a spirale	Ø 2.8 mm		
38162		TL/BL Fresa helicoidal	Ø 3.5 mm		
38163			Ø 4.2 mm		
38164		Limitador de profundidade		L 14.0 mm	
38165		Stop di profondità		L 12.0 mm	
38166		Tope de profundidad		L 10.0 mm	
38167				L 8.0 mm	
38168				L 6.0 mm	

EXTENSÕES | ESTENSIONE | EXTENSIONES

38158		TL/BL Broca helicoidal TL/BL Frese a spirale TL/BL Fresa helicoidal	Ø 2.2 mm	L 34.0 mm
38159		TL/BL Broca helicoidal TL/BL Frese a spirale TL/BL Fresa helicoidal	Ø 3.25 mm	L 34.0 mm
38172		Limitador de profundidade Stop di profondità Tope de profundidad		L 4.0 mm

38271		BLT DRILL-STOP-CONTROL SET	Conteúdo: 1 unidade de cada referência 38164-38172, 38260-38264		
		BLT DRILL-STOP-CONTROL SET	Contenuto: 1 pz. ciascuno degli articoli 38164-38172, 38260-38264		
		BLT DRILL-STOP-CONTROL SET	Contenido: 1 u. de las referencias 38164-38172, 38260-38264		
		<i>Não indicado para para implantes CONICAL e BLT; Ø 3.75 mm implantes apenas em combinação com o artigo 38159</i> <i>Non idoneo per impianti CONICAL e BLT; impianti Ø 3.75 mm solo in associazione all'articolo 38159</i> <i>No indicado para los implantes CONICAL y BLT; para implantes de Ø 3.75 mm sólo en combinación con el artículo 38159</i>			
38170		Broca piloto Fresa pilota Fresa piloto	Ø 1.8 mm 5 un. 5 pz. 5 uu.	L 34.0 mm	
38260		BLT Broca helicoidal	Ø 2.2 mm	L 37.9 mm	
38261		BLT Frese a spirale	Ø 2.8 mm		
38264		BLT Fresa helicoidal	Ø 3.25 mm		
38262			Ø 3.5 mm		
38263			Ø 4.2 mm		
38164		Limitador de profundidade		L 14.0 mm	
38165		Stop di profondità		L 12.0 mm	
38166		Tope de profundidad		L 10.0 mm	
38167				L 8.0 mm	
38168				L 6.0 mm	
38172				L 4.0 mm	

▶ OKTAGON® · ACESSÓRIOS | ACCESSORI | ACCESORIOS

KITS CIRÚRGICOS | CASSETTA CHIRURGICA | CAJAS QUIRÚRGICAS

<p>82890</p> 	<p>OKTAGON® Kit Cirúrgico Mini BLT (sem conteúdo) OKTAGON® Casseta chirurgica MINI BLT (senza contenuto) OKTAGON® Kit Quirúrgico MINI BLT (sin contenido)</p>	
<p>82893</p> 	<p>OKTAGON® Kit Cirúrgico Mini (sem conteúdo) OKTAGON® Casseta chirurgica MINI (senza contenuto) OKTAGON® Kit Quirúrgico MINI (sin contenido)</p>	<p>a pedido su richiesta previa solicitud</p>
<p>82898</p> 	<p>OKTAGON® Kit Cirúrgico (sem conteúdo) OKTAGON® Casseta chirurgica (senza contenuto) OKTAGON® Kit Quirúrgica (sin contenido)</p>	



Em <https://www.meisingerimplants.com> vai encontrar

- ▶ mais informações sobre kits cirúrgicos
- ▶ indicações gerais de aplicação e segurança sobre dispositivos médicos
- ▶ indicações sobre preparação (limpeza, desinfecção e esterilização)
- ▶ informação sobre a estabilidade dos implantes e medição da osteointegração para todos os implantes OKTAGON®
- ▶ Formulário de garantia

All'indirizzo <https://www.meisingerimplants.com> è possibile trovare

- ▶ ulteriori informazioni sulle cassette chirurgiche
- ▶ avvertenze generali per l'uso e la sicurezza relative ai prodotti destinati al settore medico
- ▶ avvertenze per il ricondizionamento (pulizia, disinfezione e sterilizzazione)
- ▶ informazioni relative alla misurazione della stabilità dell'impianto e all'osteointegrazione per tutti gli impianti OKTAGON®
- ▶ modulo di garanzia

En <https://www.meisingerimplants.com> encontrará

- ▶ más información sobre las cajas quirúrgicas
- ▶ instrucciones de uso e indicaciones de seguridad generales relativas a los productos sanitarios
- ▶ información sobre la estabilidad de los implantes y la medición de la osteointegración para todos los implantes OKTAGON®
- ▶ indicaciones para el tratamiento (limpieza, desinfección y esterilización)
- ▶ Formulario de la garantía


VALORES DE TORQUE E ROTAÇÃO | TORQUE E NUMERO DI GIRI | MOMENTOS & VELOCIDADES

	Ø mm	Ncm	rpm	Ferramentas Ausiliari Outils
Implantes	3.3	35	15 min ⁻¹	Cotovelo, Roda de dedo, Roquete dinamométrico
Impianti	3.75	35	15 min ⁻¹	Contrangolo, Attacco manuale, Cricchetto dinamometrico
Implantes	4.1	35	15 min ⁻¹	Contraângulo, Ruedecilla, Carraca dinamométrica
	4.8	35	15 min ⁻¹	
Broca piloto	1.54	-	600 min ⁻¹	Cotovelo
Fresa pilota	1.8		600 min ⁻¹	Contrangolo
Fresa piloto				Contraângulo
Broca esférica	2.2	-	800 min ⁻¹	Cotovelo
Fresa a rosetta				Contrangolo
Fresa de bola				Contraângulo
Broca helicoidal	2.0	-	800 min ⁻¹	Cotovelo
Fresa spirale	2.2		800 min ⁻¹	Contrangolo
Fresa helicoidal	2.8		600 min ⁻¹	Contraângulo
	3.25		500 min ⁻¹	
	3.5		500 min ⁻¹	
	4.2		400 min ⁻¹	
Broca de perfil	3.3	-	300 min ⁻¹	Cotovelo
Fresa svasata	3.75		300 min ⁻¹	Contrangolo
Fresa de perfil	4.1		300 min ⁻¹	Contraângulo
	4.8		300 min ⁻¹	
Promotor de rosca	3.3	-	15 min ⁻¹	Cotovelo
Maschiatori	3.75		15 min ⁻¹	Contrangolo
Macho de rosca	4.1		15 min ⁻¹	Contraângulo
	4.8		15 min ⁻¹	
Parafusos de fecho		à mão		Chave de parafusos
Viti di chiusura	-	manualmente	-	Cacciaviti
Tornillos de cierre		firme		Destornillador
Pilar de cicatrização		à mão		Chave de parafusos
Abutment di guarigione	-	manualmente	-	Cacciaviti
Pilares de cicatrización		firme		Destornillador
Parafusos oclusais		15		Chave de parafusos, Roquete dinamométrico
Viti occlusale	-		-	Cacciaviti, Cricchetto dinamometrico
Tornillos oclusales				Destornillador, Carraca dinamométrica
Espigão de impressão		à mão		Chave de parafusos, Roquete dinamométrico
Transfer da impronta	-	manualmente	-	Cacciaviti, Cricchetto dinamometrico
Poste de impresión		firme		Destornillador, Carraca dinamométrica
Pilares		35		Chave de parafusos, Roquete dinamométrico
Abutment	-		-	Cacciaviti, Cricchetto dinamometrico
Pilares				Destornillador, Carraca dinamométrica
ALLIGATOR		35		Ponta de chave de encaixar para roquete
ALLIGATOR	-		-	Strumento di inserimento per cricchetto
ALLIGATOR				Instrumento auxiliar de inserción para carraca

Todos os dados nesta tabela são valores recomendados.

Tutti i valori riportati nella presente tabella sono indicativi.

Todas las indicaciones de esta tabla son recomendaciones.

▶ MATERIAIS | MATERIALI | MATERIALES

Titânio Titano Titanio Grado 4 (3.7065) EN ISO 5832-2:2018	Implantes Impianti Implantos Parafusos de fecho Viti di chiusura Tornillos de cierre Matrizes, Análogos Matrici, Analoghi Matrices, Análogos Pilar de cicatrização Abutment di guarigione Pilares de cicatrización Pilares Abutments Pilares Encaixes esféricos retentivos Ancoraggio a testa sferica Anclajes de bola Pilares sólidos Abutment Solido Pilares macizos
Titânio Titano Titanio Grado 5 (3.7165 Medical Grade) EN ISO 5832-3:2017	ROX-CERA Implantes* ROX-CERA Impianti* Implantes ROX-CERA* Parafusos basais Viti di base Tornillos de base ALLIGATOR ALLIGATOR ALLIGATOR Parafuso oclusal Vite occlusale Tornillo oclusal Espigão de impressão Transfer da impronta Poste de impresión Pilares individualizáveis Abutment Personalizzabili Pilares individualizables
Aço inoxidável Acciaio inossidabile Acero inoxidable (1.4197) ASTM F 899 (2019)	Broca esférica, Broca helicoidal, Broca de perfil Fresa a rosetta, Fresi a spirale, Fresi svasate Fresa de bola, Fresa helicoidal, fresa de perfil Promotor de rosca Maschiatori Macho de rosca 48h Instrumentos de explantação 48h Strumento d'espianto 48h nstrumentos de explantación Cotovelo Contrangolo Contraângulo Chave de parafusos Cacciaviti Destornillador Pontas de chave de encaixar Strumenti di inserimento Instrumento auxiliar de inserción Guia de Paralelização, Calibrador de profundidade Guide di parallelismo, misuratori di profondità Guías de paralelismo, calibradores de profundidad Chave de retenção, Cotovelo Chiavetta di ritegno, Contrangolo Llave de retención, contraângulo
Aço inoxidável Stainless steel Acero inoxidable (1.4305) EN 10088-3:2014	Esferas de referência para raio X Sfere di riferimento per radiografia Bolas de referencia radiográfica Roquete dinâmométrico Cricchetto dinamometrico Carraca dinâmométrica
EPDM FDA CFR Title 21 (2018)	O-Rings O-ring Juntas tóricas
Polyoxymethylene (POM) EN ISO 13504:2012	Tampas Cappette Cofias
Polyetheretherketone 100 % (PEEK) EN ISO 13504:2012	Pilar de cicatrização individualizável Abutment di guarigione personalizzabile Pilar de cicatrización individualizable
Polysulfone (PSU) EN ISO 13504:2012	Pilar multifunções Abutment multifunzione Pilar multifuncional
ROX-CERA Cerid® 44 O* Cerid® 45 ON*	Informações a pedido Informazioni su richiesta Información previa solicitud

RHEIN83®

Titânio Titano Titanio Grado 5 (3.7165 Medical Grade) EN ISO 5832-3:2017	Matrizes Matrici Matriz Análogo do modelo Analogo da laboratorio Implante de laboratorio Tampa de transferência Transfer da impronta Cofia de transferencia
Ethylene-Vinylacetat-Copolymer (EVAC) CAS:24937-78-8	Colar de montagem Collare di montaggio Collar de montaje
Polyoxymethylene (POM) EN ISO 13504:2012	Ref. 16014, 16025
Nylon (Polyamid 66)	Ref. 16013, 16024, 16042
Polyether	Ref. 16011, 16012, 16022, 16023

GARANTIA DA QUALIDADE | CONTROLLO QUALITÀ | ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

VERIFICAÇÕES

Durante o processo

- Verificação do material utilizado à entrada
- Verificação final documentada incluindo uma verificação a 100% das características de funcionamento essenciais
- Verificação radiológica espectral documentada de todas as ordens de produção relativamente a resíduos de produção*
- Análise da superfície e verificação da topografia da superfície (macro/micro cluster)*
- Teste de biocarga para determinação da contagem microbiana*

Regularmente

- Teste de endotoxinas no âmbito da validação da limpeza
- Teste de partículas no âmbito da validação da limpeza
- Testes citotxicológicos em produtos embalados e esterilizados para confirmar a biocompatibilidade

Utilização de parceiros acreditados para os testes laboratoriais externos

CONTROLLI

In corso di lavorazione

- Controllo all'ingresso merci del materiale utilizzato
- Ispezione finale documentata, comprendente controllo integrale delle principali caratteristiche funzionali
- Analisi spettrale a raggi X documentata di tutti gli ordini di fabbricazione per eventuali residui di produzione degli impianti*
- Analisi delle superfici e controllo della topografia superficiale (macro-/microcluster) negli impianti*
- Analisi del bioburden per la determinazione della carica microbica negli impianti*

Regularmente

- Test delle endotossine nel quadro della convalida della pulizia
- Test delle particelle nel quadro della convalida della pulizia
- Test di citotossicità dei prodotti confezionati e sterilizzati per la conferma della biocompatibilità

Utilizzo di partner accreditati per test di laboratorio esterni

CONTROLES

Durante la fabricación

- Comprobación del material utilizado a su recepción
- Control final documentado incluida comprobación al 100 % de las principales características funcionales
- Análisis espectral por rayos X documentado de todos los pedidos de fabricación para detectar residuos de la producción*
- Análisis de las superficies y control de la topografía superficial (macro/micro cluster)*
- Análisis de la biocontaminación para determinar el número de microbios*

Regulares

- Text de endotoxinas en el marco de la validación de la limpieza
- Text de partículas en el marco de la validación de la limpieza
- Tests de citotoxicidad en productos envasados y esterilizados para confirmar la biocompatibilidad

Utilización de socios acreditados para los análisis de laboratorio externos

* em implantes | per impianti | para los implantes

CERTIFICAÇÃO | CERTIFICAZIONE | CERTIFICACIÓN

- Conformidade | Conformità | Conformidad
- ISO 13485: 2016
- Diretiva „Dispositivos médicos“ 93/42/CEE | Direttiva sui dispositivi medici 93/42/MDD | Directiva sobre productos sanitarios 93/42/CEE



Figuras exemplificativas | Immagini a titolo d'esempio | Imágenes ilustrativas



INFORMAÇÕES GERAIS | NOTE GENERALI | INFORMACIÓN GENERAL

SOBRE MEISINGER IMPLANTS | SU MEISINGER IMPLANTS | SOBRE MEISINGER IMPLANTS

A MEISINGER IMPLANTS é especializada em implantologia dentária e oferece produtos de qualidade a preços acessíveis para cirurgões maxilo-faciais, cirurgões orais, dentistas e técnicos de próteses dentárias - incluindo uma vasta gama de soluções protéticas.

MEISINGER IMPLANTS è specializzata in implantologia dentale e offre prodotti di qualità a prezzi economici a chirurghi oro-maxillo-facciali, chirurghi orali, dentisti e odontotecnici, nonché un'ampia gamma di soluzioni protesiche.

La empresa MEISINGER IMPLANTS está especializada en implantología dental y ofrece productos de calidad a precios económicos para cirujanos maxilofaciales, cirujanos orales, dentistas y técnicos dentales: con soluciones completas para las prótesis.

QUALIDADE – MADE IN GERMANY | QUALITÀ – MADE IN GERMANY | CALIDAD – MADE IN GERMANY

O nosso objetivo é o desenvolvimento, a otimização e a disponibilização de dispositivos médicos de alta qualidade a nível de materiais e processos. Para isso, a MEISINGER IMPLANTS conta em muitas áreas com o aconselhamento técnico e científico de especialistas reconhecidos em implantologia. A MEISINGER IMPLANTS, em parceria com o conhecido fabricante de qualidade comprovada, a Hager & Meisinger GmbH, consegue preços vantajosos, que transfere diretamente para os seus clientes. No mercado altamente especializado e em constante crescimento da implantologia e cirurgia, a competência profissional e a adesão do paciente são fatores decisivos para o sucesso a longo prazo dos nossos sistemas.

Il nostro obiettivo è sviluppare, ottimizzare e fornire prodotti tecnici per il settore medico caratterizzati da alta qualità in termini di materiali e procedure. MEISINGER IMPLANTS si avvale della consulenza professionale e scientifica di rinomati specialisti nel campo dell'implantologia. Con la collaborazione di Hager & Meisinger, produttore rinomato per la sua comprovata qualità, MEISINGER IMPLANTS genera vantaggi in termini di costi che vengono trasferiti direttamente al cliente. La competenza tecnica e l'accettazione dell'utilizzatore sono fattori decisivi per il successo a lungo termine dei nostri sistemi nel mercato altamente specializzato e in costante crescita dell'implantologia e della chirurgia dentale.

Nuestro objetivo es el desarrollo, la optimización y el suministro de productos médico-técnicos de alta calidad en cuanto al material y los procedimientos. MEISINGER IMPLANTS cuenta con el asesoramiento científico y profesional de renombrados especialistas de la implantología dental. Y gracias a la colaboración con el fabricante Hager & Meisinger GmbH, conocido por su calidad, en MEISINGER IMPLANTS somos capaces de generar ventajas en los precios, que transferimos directamente a los clientes. En el mercado especializado y en constante crecimiento de la implantología dental y la cirugía, la competencia profesional y la aceptación de los usuarios son factores clave para el éxito a largo plazo de nuestros sistemas.

VANTAGENS DE PREÇO | PREZZI VANTAGGIOSI | VENTAJAS EN EL PRECIO

Num contexto de aumento constante dos custos do sistema de saúde, os produtos de alta qualidade a um preço justo desempenham um papel importante para um bom nível de cuidados de saúde. A relação qualidade/preço dos produtos MEISINGER IMPLANTS beneficia os profissionais e os pacientes.

Alla luce dei costi in costante aumento del sistema sanitario, i prodotti di alta qualità al giusto prezzo rivestono un ruolo importante nell'assistenza sanitaria. L'efficienza economica dei prodotti di MEISINGER IMPLANTS va a tutto vantaggio sia dei professionisti che dei pazienti.

Debido al constante aumento de los costes en el sistema de salud, los productos de calidad a un precio justo son fundamentales para una atención sanitaria óptima. Los usuarios y los pacientes se benefician de la rentabilidad de los productos de MEISINGER IMPLANTS.

RESTAURAÇÃO CAD/CAM | RESTAURO CAD/CAM | RESTAURACIÓN CAD/CAM

Os dados de fresagem para a restauração CAD/CAM podem ser pedidos por e-mail para cadcam@meisingerimplants.com

I dati di fresatura per il restauro CAD/CAM possono essere richiesti via e-mail all'indirizzo cadcam@meisingerimplants.com

Los datos del fresado para la restauración CAD/CAM se pueden solicitar por correo electrónico en la dirección cadcam@meisingerimplants.com

FONTES DE IMAGEM | FONTI DELLE IMMAGINI | FUENTES DE LAS IMÁGENES

Adobe Stock©325837921, Adobe Stock©236809386, Adobe Stock©301744932

APLICAÇÃO DOS PRODUTOS | USO DEI PRODOTTI | USO DE LOS PRODUCTOS

Os profissionais devem possuir conhecimentos e informações sobre o manuseamento dos implantes dentários DRS International GmbH (a seguir designada por MEISINGER IMPLANTS) e sobre outros produtos distribuídos pela MEISINGER IMPLANTS para que estes possam ser usados de forma segura e profissional e de acordo com as instruções de utilização. O profissional é obrigado a utilizar o produto de acordo com as presentes instruções de utilização e a verificar se o produto é adequado à situação individual do paciente.

Gli utilizzatori devono disporre di conoscenze e informazioni adeguate sulla utilizzo degli impianti dentali di DRS International GmbH (di seguito MEISINGER IMPLANTS) e di tutti gli altri prodotti commercializzati da MEISINGER IMPLANTS, al fine di garantirne l'impiego sicuro e appropriato in conformità con le istruzioni per l'uso. È responsabilità dell'utilizzatore impiegare il prodotto in conformità con le istruzioni per l'uso e determinarne l'idoneità alla specifica situazione del paziente.

Los usuarios deben poseer los conocimientos sobre estos productos y la información relativa a la manipulación segura de los implantes dentales DRS International GmbH (en adelante MEISINGER IMPLANTS) y de otros productos distribuidos por MEISINGER IMPLANTS, para poder utilizarlos de manera segura y correcta conforme a las instrucciones de uso. El usuario está obligado a utilizar el producto conforme a las instrucciones de uso, y a comprobar si este está indicado para la situación concreta de cada paciente.

DISPONIBILIDADE | DISPONIBILITÀ | DISPONIBILIDAD

Alguns produtos MEISINGER IMPLANTS indicados no presente documento podem não estar disponíveis em todos os países. Alcuni dei prodotti di MEISINGER IMPLANTS elencati nel presente documento potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. Es posible que algunos de los productos MEISINGER IMPLANTS que aparecen en este documento no estén disponibles en todos los países.

PRODUÇÃO | PRODUZIONE | PRODUCCIÓN

Made in Germany by Hager & Meisinger GmbH, há mais de 125 anos sinónimo de dispositivos médicos de alta qualidade.

Made in Germany by Hager & Meisinger GmbH, da oltre 125 anni garanzia di dispositivi medici di alta qualità.

Made in Germany by Hager & Meisinger GmbH, desde hace más de 125 años un garante de productos sanitarios de alta calidad.

MARCAS COMERCIAIS | MARCHIO COMMERCIALE | MARCAS COMERCIALES

CEREC é uma marca registada da Dentsply Sirona, Inc. MEISINGER IMPLANTS e OKTAGON® são marcas registadas da DRS International GmbH. RHEIN83® é uma marca registada da RHEIN83 S.r.l., Itália.

CEREC è un marchio registrato di Dentsply Sirona, Inc. MEISINGER IMPLANTS e OKTAGON® sono marchi registrati di DRS International GmbH. RHEIN83® è un marchio registrato di RHEIN83 S.r.l., Italia.

CEREC es una marca registrada de Dentsply Sirona, Inc. MEISINGER IMPLANTS y OKTAGON® son marcas registradas de DRS International GmbH. RHEIN83® es una marca registrada de RHEIN83 S.r.l., Italia.

RESERVADO | RISERVA | RESERVA

Todos os dados - descrições, desenhos ou figuras neste catálogo de produtos servem apenas para a descrição do produto e não são vinculativos. A MEISINGER IMPLANTS não garante a veracidade dos dados. Salvo erro ou omissão. A reprodução, integral ou parcial, carece de autorização.

Tutti i dati (descrizioni, disegni o immagini) riportati nel presente catalogo sono intesi soltanto per la descrizione dei prodotti e non sono vincolanti. MEISINGER IMPLANTS non fornisce alcuna garanzia circa l'esattezza delle informazioni contenute in questo catalogo. Con riserva di modifiche ed errori. È vietata qualsiasi forma di riproduzione, anche parziale, senza consenso. Si applicano in via integrativa le nostre Condizioni Commerciali Generali.

Todas las informaciones (descripciones, dibujos o imágenes) de este catálogo están previstas únicamente para la descripción de los productos y no son vinculantes. MEISINGER IMPLANTS no se hace responsable de la exactitud de las indicaciones. Queda reservado el derecho a realizar cambios y a los errores. La reproducción, entera o parcial, requiere nuestra autorización.



nUNCIFARMA

MEDICAL SUPPLIES



Contacte-nos para mais informações:

Telefone: +351 219 749 392

E-mail: info@nuncifarma.pt

